

# HIOKI

---

---

取扱説明書

## LR5021

## 温度口ガー

日置電機株式会社

2013年7月 発行 改訂2版 LR5021A980-02 13-07H

---



\*600329022\*



# 目次

はじめに.....	1
梱包内容の確認.....	2
安全について.....	4
ご使用にあたっての注意.....	5
測定前の準備～データ解析までの流れ.....	7

## 第 1 章 概要 11

1.1 製品概要・特長.....	11
1.2 各部の名称と機能、表示部の説明.....	12
1.3 画面構成.....	14

## 第 2 章 測定前の準備 17

2.1 電池を取り付ける（交換する）.....	17
2.2 温度センサを接続する.....	20
2.3 PC アプリをインストールする.....	22

## 第 3 章 設定 29

3.1 設定項目一覧.....	29
3.2 本器で設定する.....	30
3.3 PC アプリで設定する.....	34

## 第 4 章 測定・解析 41

4.1 測定前の点検.....	41
4.2 本器を設置する.....	42
4.3 記録を開始・停止する.....	43
4.4 現在の測定値、記録データを確認する.....	45
4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む （保存する）、グラフ表示する.....	46

4.6	手動で記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する .....	56
4.7	保存済みの記録データをグラフ表示する .....	59
4.8	記録データを印刷する .....	61
<b>第5章</b>		
<b>記録データを加工する .....</b>		<b>63</b>
5.1	スケーリングする .....	65
5.2	電力を演算する .....	66
5.3	電気料金を計算する .....	67
5.4	稼働率を計算する .....	68
5.5	積算する .....	69
5.6	露点温度を計算する .....	70
5.7	2つの項目を使用して演算する .....	71
5.8	上下限值から外れたデータを指定した値に変換する .....	72
<b>第6章</b>		
<b>データを整理する .....</b>		<b>73</b>
6.1	データをコピーする、移動する .....	74
6.2	データを削除する .....	75
6.3	データを合成する .....	76
6.4	データを切り出す .....	77
<b>第7章</b>		
<b>オプション設定 (PC アプリ) .....</b>		<b>79</b>
7.1	取りこみデータの保存方法を変更する .....	80
7.2	接続監視方法、データミニ設定画面の機能設定を 変更する .....	81
<b>第8章</b>		
<b>仕様 .....</b>		<b>83</b>
8.1	測定仕様 .....	83
8.2	機能仕様 .....	84
8.3	その他 .....	85
8.4	LR5091 通信アダプタ仕様 .....	86

---

---

8.5 温度センサ仕様 .....	89
<b>第9章</b>	
<b>保守・サービス</b> .....	<b>91</b>
9.1 クリーニング .....	91
9.2 本器を廃棄するときは .....	91
9.3 困ったときは .....	92
9.4 エラー表示 .....	94
<b>付録</b> .....	<b>付1</b>
付録1 記録モードについて .....	付1
付録2 記録間隔と最大記録時間 .....	付2
付録3 電池寿命の目安 .....	付2
<b>索引</b> .....	<b>索1</b>





## はじめに

このたびは、HIOKI LR5021 温度ロガー（「データミニ」シリーズ）をご選定いただき、誠にありがとうございます。この製品を十分に活用いただき、末長くご使用いただくためにも、取扱説明書はていねいに扱い、いつもお手元に置いてご使用ください。

### 登録商標について

Windows は米国マイクロソフト社の登録商標です。

### 表記について

	してはいけない行為を示します。
(⇒ p. )	参照先を示します。
	操作のクイックリファレンス、トラブル対処法について記述しています。
*	説明を下部に記述しています。
[ ]	メニュー名、コマンド名、ダイアログ名、ダイアログ内のボタンなどの画面上の名称、およびキーは [ ] で囲んで表記しています。
<b>SET</b> (太字)	文中の太字の英数字は、操作キーに示されている文字を示します。
Windows	特に断り書きのない場合、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 を「Windows」と表記しています。
ダイアログ	Windows のダイアログボックスは「ダイアログ」と表記しています。
本器	LR5021 温度ロガーを以降「本器」と記載します。
温度センサ	K 熱電対、温度プローブを総称して「温度センサ」と記載します。

本器では、画面表示を次のように表記しています。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	b	c	d	E	F	G	H	I	J	K	L	ñ	o	P	q	r	S	t	U	u	v	w	x	y	z

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0





## ◆ マウス操作について

クリック	マウスの左ボタンを押して、すぐに離します。
右クリック	マウスの右ボタンを押して、すぐに離します。
ダブルクリック	マウスの左ボタンをすばやく2回クリックします。
ドラッグ	マウスの左ボタンを押したままマウスを移動し、目的の位置でボタンを離します。
アクティブ	画面上をクリックして、その画面を有効にすることです。

## 梱包内容の確認

本器がお手元に届きましたら、輸送中において異常または破損がないか点検してからご使用ください。特に付属品および、パネル面のスイッチ、端子類に注意してください。万一、破損あるいは仕様どおり動作しない場合は、お買上店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。

( )内は数量を示します。

<input type="checkbox"/> 本体 (1) 	付属品 <input type="checkbox"/> 単3形アルカリ乾電池 (LR6) (2) (出荷時は、本体に取り付け済み)  <input type="checkbox"/> 取扱説明書 (1)  <input type="checkbox"/> 操作ガイド (1) 
---	--

参照: そのほかご指定のオプション製品: 「オプションについて」 (⇒ p.3)



## オプションについて

本器には、下記のような別売りオプションがあります。別途ご購入いただいている場合は、あわせてご確認ください。

- LR5091 通信アダプタ (1)  
(PC アプリ (CD-R)\*、  
USB ケーブル付属)




参照: LR5091 の仕様 : (⇒ p.86)

- LR5092 データコレクタ  
(PC アプリ (CD-R)\*、USB ケーブル、  
単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) (2 本)、  
取扱説明書、操作ガイド付属)



\*: 最新バージョンは、弊社ホームページからダウンロードできます。

- Z5004 マグネット付きストラップ



参照: 取り付け方法  
:(⇒ p.42)


- LR9691 K 熱電対コネクタ  
(ミニチュアプラグ)




- LR9692 K 熱電対  
(長さ約 2 m)  
(ミニチュアプラグ付き)




- 9472-50 シース形温度プローブ  
(長さ約 1 m)



- 9473-50 シース形温度プローブ  
(長さ約 1 m)



- 9476-50 表面形温度プローブ  
(長さ約 1 m)



参照: 温度センサの仕様 : (⇒ p.89)

## 輸送上の注意

本器を輸送する場合は、お届けしたときの梱包材料をご使用ください。輸送中に破損しないように梱包し、故障内容も書き添えてください。輸送中の破損については保証しかねます。

## 安全について

この取扱説明書には本器を安全に操作し、安全な状態に保つのに要する情報や注意事項が記載されています。本器を使用する前に下記の安全に関する事項をよくお読みください。

### **⚠ 危険**

この機器は IEC 61010 安全規格に従って、設計され、試験し、安全な状態で出荷されています。測定方法を間違えると人身事故や機器の故障につながる可能性があります。また、本器をこの取扱説明書の記載以外の方法で使用した場合は、本器が備えている安全確保のための機能が損なわれる可能性があります。

取扱説明書を熟読し、十分に内容を理解してから操作してください。万一事故があっても、弊社製品が原因である場合以外は責任を負いかねます。

### 安全記号

本体に記されているマークについて説明します。



使用者は、取扱説明書内の **⚠** マークのあるところは、必ず読み注意する必要がありますを示します。



使用者は、機器上に表示されている **⚠** マークのところについて、取扱説明書の **⚠** マークの該当箇所を参照し、機器の操作をしてください。



直流 (DC) を示します。

### 規格に関する記号

本体に記されているマークについて説明します。



欧州共同体閣僚理事会指令 (EC 指令) が示す安全規制に適合していることを示します。



EU 加盟国における、電子電気機器の廃棄にかかわる法規制 (WEEE 指令) のマークです。

### 危険レベル

取扱説明書の注意事項には、重要度に応じて以下の表記がされています。



**⚠ 危険** 操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷につながる危険性が極めて高いことを意味します。



**⚠ 警告** 操作や取り扱いを誤ると、使用者が死亡または重傷につながる可能性があることを意味します。



**⚠ 注意** 操作や取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う場合、または機器を損傷する可能性があることを意味します。



**注記** 製品性能および操作上でのアドバイスを意味します。

## ご使用にあたっての注意

本器を安全にご使用いただくために、また機能を十二分にご活用いただくために、下記の注意事項をお守りください。

### 設置時の注意

使用温湿度範囲：0～50℃、80%rh 以下（結露なきこと）

保存温湿度範囲：-10～60℃、80%rh 以下（結露なきこと）

本器の故障、事故の原因になりますので、以下のような場所には設置しないでください。



直射日光が当たる  
場所  
高温になる場所



腐食性ガスや爆発性  
ガスが発生する場所



水、油、薬品、溶剤な  
どのかかる場所  
多湿、結露するよう  
な場所



強力な電磁波を発生  
する場所  
帯電しているもの  
近く



機械的振動の多い  
場所



誘導加熱装置の近く  
(高周波誘導加熱装  
置、IH調理器具など)

### ⚠ 注意

- 本器は防じん・防水構造になっていません。ホコリの多い環境や水のかかる環境下で使用しないでください。故障の原因になります。
- 温度センサは防滴構造になっていません。コネクタ部に水滴が付着すると、故障の原因になりますので、注意してください。
- 本器の損傷を避けるため、センサコネクタから信号を入力しないでください。温度センサの使用温度範囲については、「8.5 温度センサ仕様」(⇒ p.89) に記載されている各温度センサの仕様を参照してください。弊社オプション LR9691 K 熱電対コネクタを使用すれば、市販の K 熱電対も使用できます。
- 本器に油などが付着したままの状態では長時間使用すると、ケースの変形や破損につながりますので注意してください。
- 温度センサのシースの中には酸化マグネシウムの粉末が充填されています。万が一、センサが破損した場合、酸化マグネシウムの粉末が流出する可能性がありますので、シースに過度な力が加わらないように取り扱いにご注意ください。酸化マグネシウム粉末を大量に摂取すると健康を損なう恐れがあります。

## 本器の損傷を防ぐために



### 注意

本器の損傷を防ぐため、運搬および取り扱いの際は振動、衝撃を避けてください。特に、落下などによる衝撃に注意してください。

## CD-R の取り扱いについて



### 注意

- ディスクに指紋などの汚れを付けないようにするため、また印刷がくすねないようにするため、お取り扱いの際は必ずディスクの縁を持つようにしてください。
- ディスクの記録面には決して手を触れないようにしてください。また堅いものの上に直接置かないようにしてください。
- ディスクのレーベル表示が消える可能性がありますので、ディスクを揮発性アルコールや水にぬらさないようにしてください。
- ディスクのレーベル面に文字を記入するときは、先がフェルトの油性ペンをご使用ください。ディスクを傷つけ記録内容を破損する危険性がありますので、ボールペンやその他の先の堅いペンは使用しないでください。また粘着性ラベルも使用しないでください。
- ディスクがゆがんだり記録内容が破損する危険性がありますので、直射日光や高温多湿の環境にディスクをさらさないでください。
- ディスクのシミやホコリ、指紋などを取り除く場合には、柔らかく乾いた布または CD クリーナーをお使いください。常に内側から外側に向けてめぐうようにし、決して輪を描くようにはふかないでください。また、研磨剤や溶剤系クリーナーは使用しないでください。
- この CD-R のご使用にあたってのコンピュータシステム上のトラブル、および製品の購入に際してのトラブルについて、弊社は一切の責任を負いません。

## 使用前の確認

使用前には、保存や輸送による故障がないか、点検と動作確認をしてから使用してください。故障を確認した場合は、お買上店（代理店）が最寄りの営業所にご連絡ください。



### 警告

温度センサの被覆が破れたり、金属が露出していないか、使用する前に確認してください。損傷がある場合は、感電事故になるので、弊社指定のものとの交換してください。






## 測定前の準備～データ解析までの流れ

測定前の準備からデータ解析までの流れを、代表的な測定例に沿って説明します。


ケース：倉庫の温度変化を 10 分間隔で 1 ヶ月間記録し、データをコンピュータに取り込んで保存したい。

### 用意するもの：


( ) 内は数量を示します。

<input type="checkbox"/> 本体 (1)	<input type="checkbox"/> 単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) (2)	<input type="checkbox"/> LR9692 K 熱電対 (1)
		
	<input type="checkbox"/> LR5091 通信アダプタ (1) (PC アプリ (CD-R)、USB ケーブル)	<input type="checkbox"/> コンピュータ (1)
		

### 手順：




1 本器に電池を取り付ける。  
参照：「2.1」(⇒ p.17)



2 本器に LR9692 K 熱電対を取り付ける。  
参照：「2.2」(⇒ p.20)

3



3 コンピュータにPCアプリをインストールする。

参照:「2.3」(⇒ p.22)

4



4 データミニの記録間隔を選択する。(例: 10分)

参照:「記録間隔を設定する」(⇒ p.30)

(PC アプリでも設定できます。(⇒ p.37))

5



5 データミニの日付、時刻を現在日時に合わせる。(例: 2010年5月15日、13:00)

参照:「現在の年月日時分を設定する」  
(⇒ p.30)

(PC アプリでは、データミニの時刻をコンピュータの時刻に合わせることができます。(⇒ p.40))


6




6 停止方法を [OFF] に設定する。  
(ワンタイム測定に設定されます。メモリがいっぱいになると記録は停止します)

参照:「停止方法(メモリがいっぱいになったときの処理方法)を設定する」(⇒ p.31)

(PC アプリでも設定できます。(⇒ p.37))

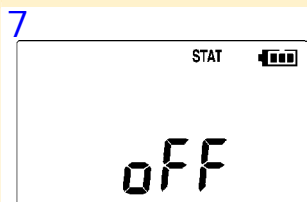

- 7 記録モードを **[OFF]** に設定する。  
 (瞬時値測定に設定されます)  
**参照:** 「記録モードを設定する」 (⇒ p.32)  
 (PC アプリでも設定できます。(⇒ p.37))

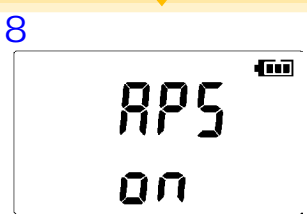


- 8 省電力設定を **[ON]** (有効) に設定する。  
 (長期記録には、省電力設定を ON (有効) にすることを勧めます)  
**参照:** 「省電力設定を設定する」 (⇒ p.32)  
 (PC アプリでも設定できます。(⇒ p.36))



- 9 CH1 測定レンジを **[200.0°C]** に設定する。


- 10 測定前の点検をする。(⇒ p.41)

- 11 データミニを倉庫の測定場所に設置する。  
**参照:** 「4.2」 (⇒ p.42)  
 (壁などに取り付けることもできます)

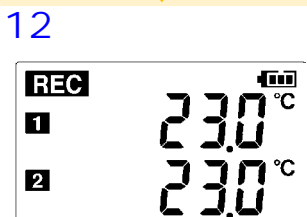

- 12 本器の**記録/停止**キーを2秒以上押して、記録を開始する。  
**参照:** 「4.3」 (⇒ p.43)

13

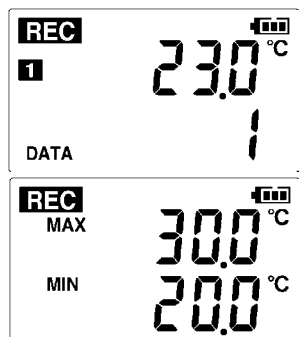

13 (+)、または (-) キーで本器の画面表示を切り替え、記録データ数が増えていくか、記録データ（最大値、最小値）が表示されるかを確認する。

(記録が確実に行われているか確認できます)


参照:「4.4」(⇒ p.45)

14 1ヶ月後、本器の記録/停止キーを2秒以上押して、記録を停止する。

参照:「4.3」(⇒ p.43)

15 倉庫から本器を持ち帰る。

16



16 本器をコンピュータに接続して、記録データをコンピュータに取り込む。グラフでデータを解析する。

参照:「4.5」(⇒ p.46)

(コンピュータにデータを取り込むと、自動的にデータは保存されます。初期設定の場合は、グラフも自動的に表示されます)

17 必要に応じて記録データを印刷する。

参照:「4.8」(⇒ p.61)



## 概要

## 第 1 章


1

第 1 冊 巻頭

## 1.1 製品概要・特長


本器は、温度の測定、表示、記録ができる小型のポータブルロガーです。

- ・ 記録しながらデータ収集可能
- ・ 記録容量は、最大 60,000 データ



大型表示部で 2 チャンネル同時表示可能

温度 (2 チャンネル) を測定できます。



PC アプリで、データの管理・閲覧が簡単

PC アプリ「LR5000 用 ユーティリティ」はインストール方法がとても簡単です。

インストール後は、自動起動・データ表示・保存で、データの管理・閲覧が簡単にできます。




- ・ 電池消耗によるデータ消去なし
- ・ 電池交換時も記録を継続 (約 30 秒)

高度な機能を搭載

- ・ 統計値記録 (⇒ p.32)、(⇒ p.37)
- ・ スケーリング (⇒ p.38)、(⇒ p.65)
- ・ アラーム表示 (⇒ p.39)

住宅、オフィス、工場、倉庫などの環境測定に

ESCO・HACCP・ISO などにおける環境計測に一役買います。



測定場所



## 1.2 各部の名称と機能、表示部の説明

### 正面


#### 表示部 (⇒ p.13)

約 30 秒間何も操作しないと表示が消えます。(省電力設定) キー操作を行うと再び点灯します。

表示点灯時は、約 1 秒ごとに表示を更新します。

#### 赤外線ポート (⇒ p.46)

LR5091 通信アダプタ、または LR5092 データコレクタと通信します。



操作キー

#### 接続端子 (⇒ p.20)


温度センサを接続します。

### 背面

#### スタンド / ストラップ取り付け穴 (⇒ p.42)

ネジに引っ掛けて壁などに取り付けられます。(ネジ頭部の寸法: 直径約 6.8 mm、厚さ約 2.5 mm まで対応)

#### 電池カバー (⇒ p.17)




### 操作キー

#### 設定キー

設定画面を表示します。

#### 記録 / 停止キー


2 秒以上押すと記録を開始、または停止します。設定画面で押すと、測定画面に切り替わります。

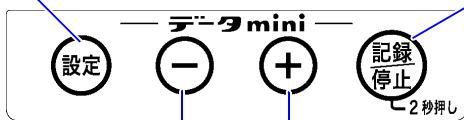

#### (-) キー、(+) キー

測定画面では、表示内容を切り替えます。  
設定画面では、各種設定値を変更します。

### LR5091 通信アダプタ



#### 赤外線ポート (⇒ p.46)

本器と通信します。

#### USB 端子 (⇒ p.34)

付属の USB ケーブルでコンピュータと接続します。(ミニ B タイプ)

## 表示部の説明

表示部に表示されるマークの意味は以下のようになります。

## REC マーク

現在記録中であることを意味します。(記録待機中は点滅します)

## AL マーク

アラーム\*判定を使用する場合に、測定値が設定した上下限值\*の範囲から外れると点灯します。

## ENDLESS マーク

停止方法設定画面時に点灯します。  
測定画面で点灯しているときは、エンドレス記録(⇒ p.31)に設定されていることを意味します。

## 電池残量表示

電池の残量を表示します。(⇒ p.18)

## MAX マーク

右の数値が最大値であることを意味します。

## 測定チャンネル

## MIN マーク

右の数値が最小値であることを意味します。

## DATA マーク

右の数値がデータ数であることを意味します。

## TIME マーク


年月日時分設定画面時に点灯します。

## INTVL マーク

記録間隔設定画面時に点灯します。

## STAT マーク

記録モード設定画面時に点灯します。  
測定画面で表示される場合は、統計値記録(⇒ p.32)に設定されていることを意味します。

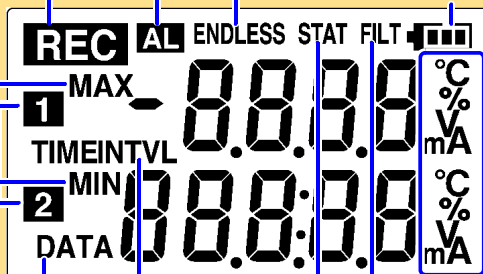

単位  
各測定チャンネルの単位を表示します。

本器では点灯しません。

\*: PC アプリ、または LR5092 データコレクタから設定できます。


参照: 「3.3 PC アプリで設定する」(⇒ p.34)、LR5092 データコレクタの取扱説明書

## 1.3 画面構成

本器の画面は、記録データを表示する「測定画面」と、設定を行う「設定画面」があります。


### 測定画面

(+)、または (-) キーで画面を切り替えます。

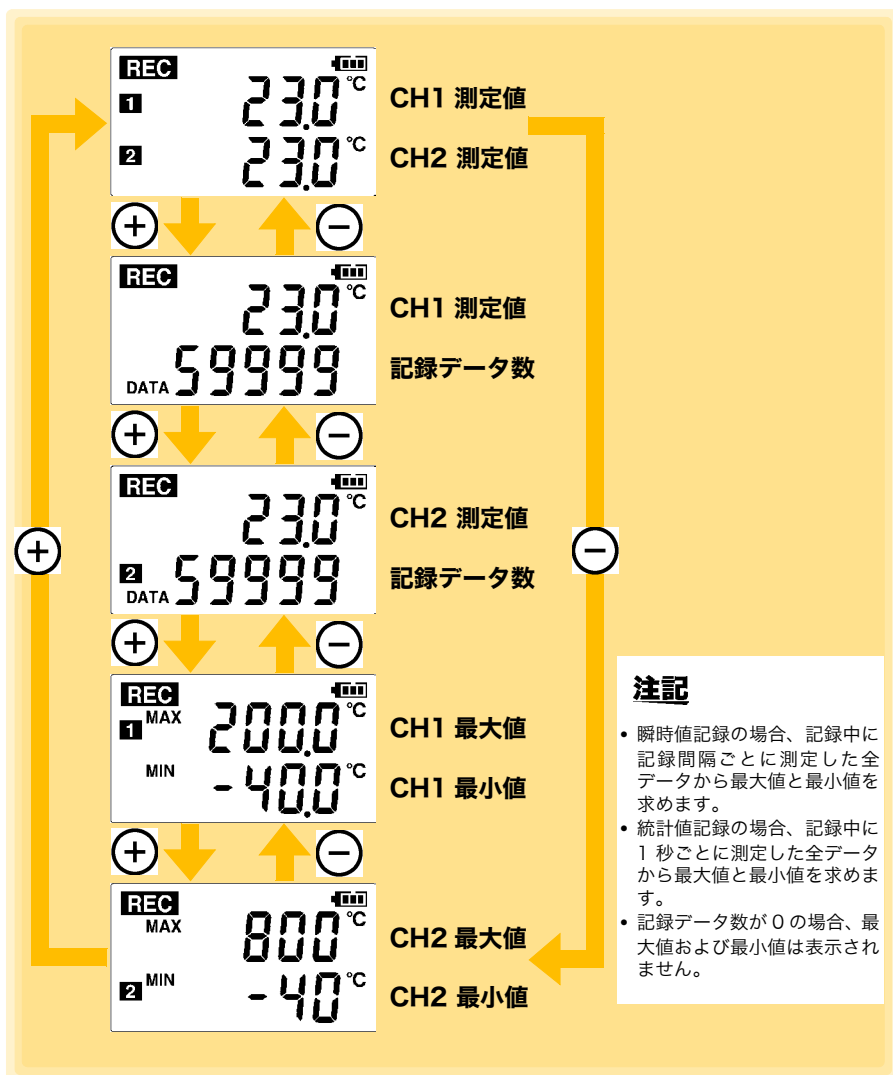

## 設定画面


設定キーで画面を切り替えます。(+)、または(-)キーで設定を変更します。  
いずれの画面からでも、記録/停止キーを押すと、測定画面に切り替わります。

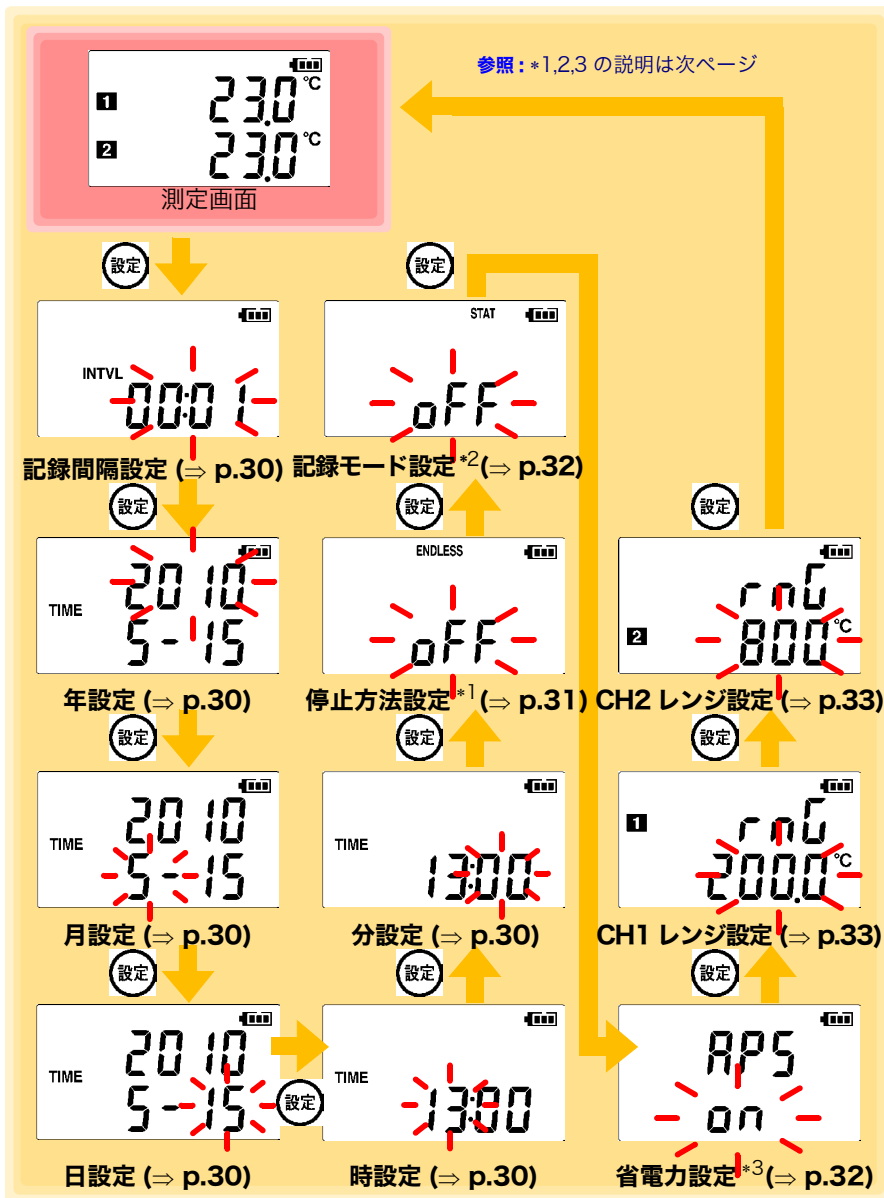

- \*1: メモリがいっぱいになったときの処理を設定します。ON は古いデータから上書き、OFF は記録を停止します。(初期設定は ON)
- \*2: ON (統計値記録) にすると、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録します。電池寿命は短くなります。(初期設定は OFF(瞬時値記録))
- \*3: ON (有効) にすると、電池寿命が長くなります。(初期設定は ON)

参照:「付録3 電池寿命の目安」(⇒ p.付2)

### 注記

- 設定画面で30秒間操作がなかった場合は、測定画面に自動で切り替わります。
  - 電池の残量表示が  の場合、設定の変更はできません。設定の確認はできます。
  - 記録中は設定変更はできません。ただし、記録中でも測定画面で**設定**キーを押すと設定を確認することができます。
-

## 測定前の準備

## 第 2 章

## 2.1 電池を取り付ける (交換する)

**警告**


- 交換後は、必ず電池カバーをして 使用してください。
- 極性＋に注意し、逆向きに入れしないでください。性能劣化や液漏れの原因になります。また必ず指定の電池と交換してください。
- 使用済の電池をショート、充電、分解または火中への投入はしないでください。破裂する恐れがあり危険です。
- 使用済の電池は地域で定められた規則に従って処分してください。

**注意**


新旧および異種の混合はしないでください。また極性＋に注意し、逆向きに入れしないでください。性能劣化や液漏れの原因になります。

**注記**

- 電池消耗時、交換時も本器に保存されているデータや測定条件は消えません。
- 電池残量表示が の場合、記録動作中に電池を抜いても、約 30 秒間は動作可能です。電池を抜いてから約 30 秒経過すると、記録動作を停止します。
- 本器には検査用モニタ電池が入っていますが、電池によっては消耗している場合があります。長期間の測定を行う場合など、新しい電池と交換することをお勧めします。
- 本器の使用電源は単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) です。マンガン乾電池は測定や LR5091 通信アダプタ、および LR5092 データコレクタとの通信ができないことがありますので使用しないでください。
- 電池取り付け後、次のように画面が表示されますので、現在の年月日時分を設定してください。(⇒ p.30)



1. 全点灯



4. 年設定画面




2. 機種名



3. ソフトバージョン




## 2.1 電池を取り付ける (交換する)

- 注記**
- 電池の残量表示が  の場合、設定の変更はできません。設定の確認はできません。
  - 本器が正常に動作できない電圧になると、次のような画面が表示されます。電池交換により正常な状態に復帰できます。



### 電池残量表示について

表示部右上に表示されます。

	電池残量あり。残量が減るにつれて左からマーク内の目盛りが消えていきます。
	電池が消耗していますので早めに交換してください。(記録動作中に電池を抜いても、約30秒間は動作可能です)
	電池残量なし。この状態では記録、および LR5091 通信アダプタまたは LR5092 データコレクタとの通信はできません。

### ニッケル水素充電電池の使用について

ニッケル水素充電電池を使用すると、電池残量表示は正しい残量を表示しません。

また、電池寿命も容量、充電状態、繰り返し使用による劣化等によって大きく変わります。この点を考慮の上、使用してください。

本器の電池残量表示、電池寿命は新品アルカリ乾電池の使用を前提としています。







### 本器を長期間使用しないときは

- 注記** 電池の液漏れによる腐食と本器の損傷を防ぐため、長い間 (1 週間) 使用しないときは、電池を抜いて保管してください。



## 取り付け方法 (交換方法)

用意するもの: 単3形アルカリ乾電池 (LR6)(2本)

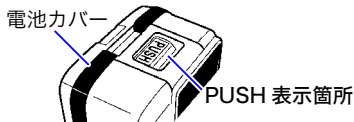

- 1 PUSH 表示箇所をイラストのように押しながら、電池カバーを背面側にずらす。
- 2 電池カバーを持って、本体から外す。
- 3 イラストのように電池を取り付ける。
- 4 本体背面の突起に電池カバーの窪みを合わせる。
- 5 合わせた部分に隙間が空かないように、指で押さえながら電池カバーを閉める。

電池を取り付けると、電源が入ります。  
(電源スイッチはありません)

**注記** 防じん・防滴構造のため、電池カバーの取り外し、取り付けが多少きつく感じるかもしれませんが、ご了承ください。  
突起と窪みをきちんと合わせるとスムーズに電池カバーが閉まります。



隙間が開いている状態で電池カバーを閉めると、カバーがきちんと閉まりません。



NG の状態から無理やり電池カバーを閉めないでください。故障の原因になります。

## 2.2 温度センサを接続する



温度センサを本器の接続端子に接続します。

### 警告


- 短絡事故や感電事故を防ぐため、電圧のかかっている場所の温度測定はしないでください。
- CH1-CH2 端子間は絶縁されていません。短絡事故にご注意ください。被測定部の電位が異なる場合は、絶縁テープなどで絶縁して温度センサを取り付けてください。

### 注意

- 温度センサに過度の衝撃を加えたり、リード線を無理に曲げないでください。故障や断線の原因になります。
- 温度センサが指定の温度範囲を超えないよう注意してください。
- 断線による故障を防ぐため、温度センサの付け根を折ったり引っ張ったりしないでください。
- コード類の被覆に損傷を与えないため、踏んだり挟んだりしないでください。
- 本器の損傷を避けるため、接続端子に電圧を入力しないでください。

## 接続方法

用意するもの：弊社指定の LR9692 K 熱電対、9472-50 シース形温度プローブ、9473-50 シース形温度プローブ、9476-50 表面形温度プローブ（または LR9691 K 熱電対コネクタと市販の K 熱電対）

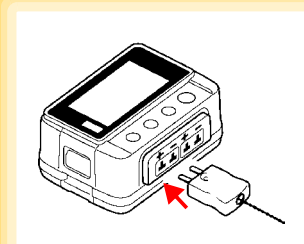

本器の接続端子の +、- マークと温度センサのコネクタの +、- マークを合わせて奥まで押し込む。（コネクタピンの幅が左右で異なるため、無理に逆向きに押し込まないでください）


センサが十分に奥まで差し込まれていないと正しい値を表示しません。



十分に奥まで差し込んでも正しい値が表示されない場合は、本体、またはセンサの故障が考えられます。修理に出してください。

参照：「修理に出すときは」(⇒ p.91)

LR9691 に市販の K 熱電対を接続する場合

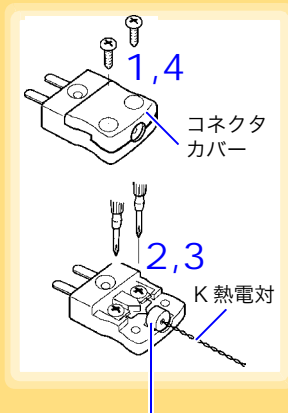

- 1 ネジ 2 本を外し、コネクタカバーを外す。
- 2 コネクタ内部のネジ 2 本を緩める。
- 3 K 熱電対を接続してネジを留める。
- 4 コネクタカバーを取り付けてネジを留める。

ケーブル引き出し部は  $\phi 4$  mm までのケーブルに対応可能です。(1 mm 以下の細い熱電対の場合は付属の白いゴムに通して取り付けてください)

## 対応センサ

LR9692 K 熱電対  
9472-50 シース形温度プローブ  
9473-50 シース形温度プローブ  
9476-50 表面形温度プローブ

## 2.3 PC アプリをインストールする

本器のデータをコンピュータで保存、閲覧、印刷したい場合、本器の設定をコンピュータで行いたい場合は、PC アプリ「LR5000 用 ユーティリティ」をコンピュータにインストールしておきます。

### LR5000 用 ユーティリティの動作環境


CPU	動作クロック 1 GHz 以上
メモリ	512 MB 以上
OS	Windows XP: SP2 以上 Windows Vista: SP1 以上 Windows 7
ライブラリ	.NET Framework 2.0/3.5
インタフェース	USB
モニタ解像度	1024 × 768 ドット以上
ハードディスク	空き容量 30 MB 以上 (上記に加え、記録データの保存用に別途空き容量が必要です。 .NET Framework 2.0 または 3.5 がインストールされていない場合は、別途約 500 MB)

### インストール手順

「administrator」などの管理者権限でログインします。

インストールを開始する前に、コンピュータで起動している全てのアプリケーションを終了させてください。


用意するもの：本器付属の CD-R、  
(Windows XP の場合) LR5091 通信アダプタ、USB ケーブル

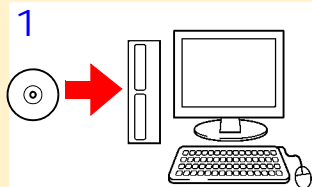

- 1 コンピュータの CD-ROM ドライブに CD-R をセットする。

自動再生機能で、CD-R 内に入っている html ファイルがブラウザで表示されます。

- 2 画面上の [簡単インストール]、または [詳細インストール] ボタンをクリックする。  
PC アプリとデバイスドライバのインストールが始まります。
- 3 セキュリティの警告画面が表示された場合は [実行] をクリックする。
- 4 インストール終了後、Windows の [スタート] メニューから、  
[すべてのプログラム]-[HIOKI]-[LR5000 用ユーティリティ]-[LR5000 ユーティリティ] を選択し、プログラムを起動する。  
メイン画面 (⇒ p.25) が表示されます。

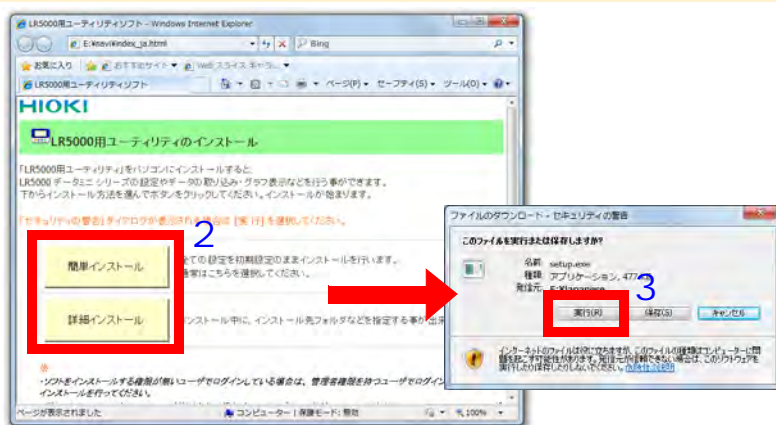

### ❓ PC アプリを起動したいときは？

次回 Windows ログオン時からは、PC アプリが自動起動します。(タスクトレイにアイコンが表示されます (⇒ p.34))  
アイコンをクリックして、[メイン画面を表示する] をクリックします。

### ❓ インストール画面が表示されないときは？

- X:\Japanese\Setup.exe を実行します。(X: は CD-ROM のドライブ)  
Setup.exe 実行後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。  
(.NET FrameWork 2.0 または 3.5 がインストールされていない環境では、最初に .NET FrameWork 2.0 のインストールが始まります)
- インストールの途中で、コンピュータの再起動を要求されることがあります。  
再起動後に、インストールが再開されなかった場合は、再度 Setup.exe を実行してください。


**注記** LR5000 「データミニ」シリーズ以外のデータミニの、設定と記録データの取り込みには、3911、3912 コミュニケーションベースに付属する「COMMUNICATION UTILITY」を使用してください。取り込んだ記録データの閲覧は、LR5000 用 ユーティリティでも行えます。

**注記** アンインストールまたはバージョンアップ時に、各種設定や記録データは削除されません。

### アンインストール手順

PC アプリ「LR5000 用 ユーティリティ」をコンピュータからアンインストールしたいときは、下記の手順で行います。

1. [スタート]-[コントロールパネル] をクリックする。  
([コントロールパネル] ダイアログが表示されます)
2. [プログラムのアンインストール] をクリックする。  
([プログラムと機能] の画面が表示されます)
3. [LR5000 用 ユーティリティ] をクリックして、[アンインストール] ボタンをクリックする。  
(アンインストールの確認ダイアログが表示されます)
4. [はい] をクリックします。  
(PC アプリがアンインストールされます)

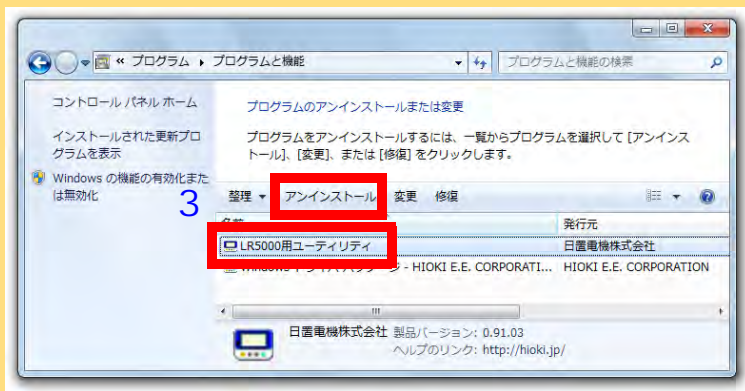

### バージョンアップ手順

LR5000 用 ユーティリティの最新バージョンは、弊社ホームページからダウンロードできます。(http://www.hioki.co.jp)

ダウンロードページのインストール手順に従い、新しいバージョンをインストールする。  
(旧バージョンは自動的にアンインストールされます)

## LR5000 用 ユーティリティの画面構成

## メイン画面 (⇒ p.34)

データ取り込み画面を表示します。

- データミニのデータ取り込み画面

オプション画面を表示します。


ヘルプを表示します。

設定画面を表示します。

- データミニの設定画面

データを見る画面を表示します。

データを整理する画面を表示します。

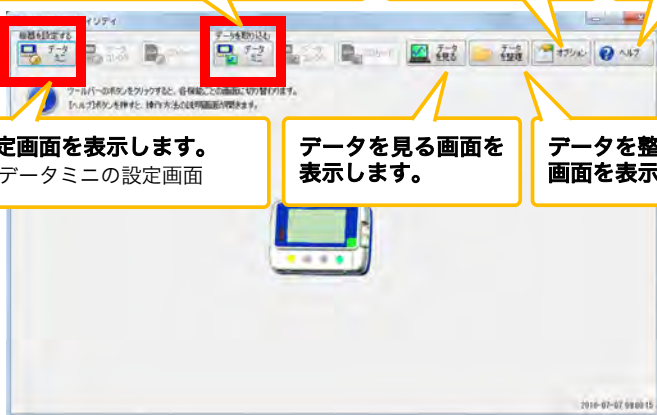

## 設定画面 (⇒ p.35)

データミニの設定・設定送信を行う画面です。

例: データミニの設定画面



### データ取り込み画面 (⇒ p.56)

データミニのデータを取り込む画面です。

例：データミニの取り込み画面




### データを見る画面 (⇒ p.59)

取り込んだデータを見る画面です。

見たいファイルを選択して、グラフや表を表示できます。

例：最新データを見る画面

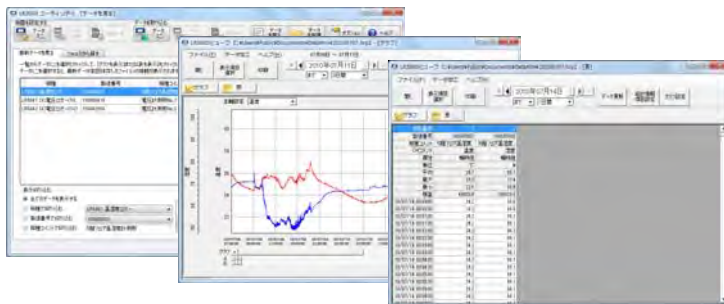



### データを整理画面 (⇒ p.73)

取り込んだデータを整理する画面です。  
データのコピー、削除、移動、合成、切り出しができます。

例：データのコピー画面



### オプション画面 (⇒ p.79)

詳細設定をする画面です。  
データの取り込み方法などを変更できます。

例：取り込み方法設定画面





# 設定

# 第3章

測定を開始する前に、測定条件を設定します。

PC アプリ「LR5000 用 ユーティリティ」でも本器の設定が行えます。(⇒ p.34)


## 3.1 設定項目一覧

設定項目一覧を下記に示します。PC アプリではすべての項目を設定できますが、本器で設定できる項目は一部限られています。

設定項目	設定内容	本器	参照箇所	PC アプリ	参照箇所
記録間隔	記録間隔を選択します。	○	(⇒ p.30)	○	(⇒ p.37)
現在の年月日時分	現在の年月日時分を設定します。(PC アプリでは、コンピュータの時刻を本器に送信できます)	○	(⇒ p.30)	○	(⇒ p.40)
停止方法	メモリがいっぱいになったときの処理方法を選択します。	○	(⇒ p.31)	○	記録停止方法に含まれます
記録モード	瞬時値記録、または統計値記録(1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録)を選択します。	○	(⇒ p.32)	○	(⇒ p.37)
省電力設定	ON(有効)にすると、電池寿命が長くなります。	○	(⇒ p.32)	○	(⇒ p.36)
測定レンジ	測定レンジを選択します。	○	(⇒ p.33)	○	(⇒ p.38)
機種コメント	データミニ識別用のコメントを設定します。	×	-	○	(⇒ p.36)
CH コメント	測定チャンネル識別用のコメントを設定します。	×	-	○	(⇒ p.36)
記録開始方法	記録開始方法を選択します。(開始時刻を予約することもできます)	×	-	○	(⇒ p.37)
記録停止方法	記録停止方法を選択します。(停止時刻を予約することもできます)	×	-	○	(⇒ p.37)
スケールリング	測定した値を任意の調整した値で表示するための設定をします。	×	-	○	(⇒ p.38)
アラーム判定	上下限値を設定して、測定値がその範囲から外れると、本器の表示部に [AL] マークを表示します。	×	-	○	(⇒ p.39)

## 3.2 本器で設定する

各設定画面から測定画面に切り替えるときは、設定確定後、**記録 / 停止**キーを押します。

- 注記**
- 電池の残量表示が  の場合、設定の変更はできません。設定の確認はできます。
  - 設定画面で30秒間操作がなかった場合は、測定画面に自動で切り替わります。
  - 記録中は設定変更はできません。ただし、記録中でも測定画面で**設定**キーを押すと設定を確認することができます。


### 記録間隔を設定する



- 1 **設定**キーを押して、記録間隔設定画面を表示する。(表示部に [INTVL] 表示、設定が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、記録間隔を選択する。  
設定例) 1秒 : 00:01、1分 : 01 : 00
- 3 **設定**キーを押して、設定を確定する。  
(年設定画面に切り替わります)

記録間隔 1 (初期設定)/2/5/10/15/20/30 秒、1/2 /5/10/15/20/30/60 分

### 現在の年月日時分を設定する

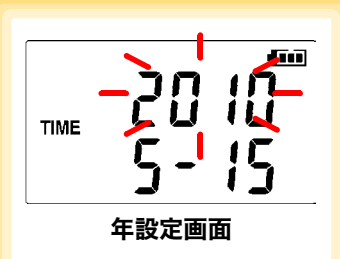


- 1 **設定**キーを押して、年設定画面を表示する。(表示部に [TIME] 表示、年が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、年を変更する。
- 3 **設定**キーを押して、年を確定する。  
(月が点滅)
- 4 同様に月、日、時、分も設定する。
- 5 **設定**キーを押して、設定を確定する。  
(停止方法設定画面に切り替わります)

設定可能範囲 2010年1月1日00:00～2039年12月31日23:59

※秒の設定はできません。設定を変更して、分設定画面を抜けた瞬間に0秒に設定されます。

- 注記** 長期間電池を抜いていた後に使用するとき、時刻がずれてきたときなどに、必要に応じて設定しなおしてください。


## 停止方法 (メモリがいっぱいになったときの処理方法) を設定する

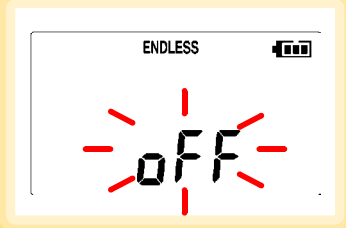



- 1 **設定**キーを押して、停止方法設定画面を表示する。(表示部に [ENDLESS] 表示、設定が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、[ON]、または [OFF] を選択する。
- 3 **設定**キーを押して、設定を確定する。(記録モード設定画面に切り替わります)

設定内容	説明
OFF	メモリがいっぱいになると、記録を停止します。(ワンタイム記録)
ON(初期設定)	メモリがいっぱいになると、古いデータから上書きします。(エンドレス記録)


**注記** ワンタイム記録でメモリがいっぱいになった場合は、記録データ数の表示が下記ようになります。

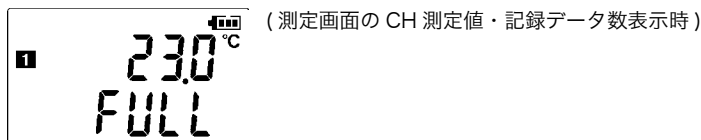

エンドレス記録で記録容量の上限まで記録した場合は、記録容量の上限を表示し続けます。

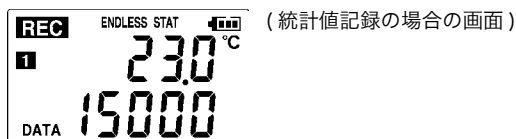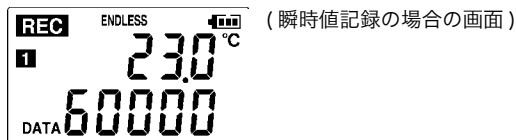

## 記録モードを設定する

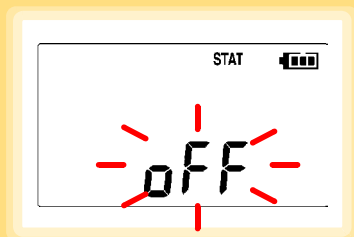


- 1 **設定**キーを押して、記録モード設定画面を表示する。(表示部に **[STAT]** 表示、設定が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、**[ON]**、または **[OFF]** を選択する。
- 3 **設定**キーを押して、設定を確定する。  
(省電力設定画面に切り替わります)

設定内容	説明
OFF (初期設定)	記録間隔ごとの瞬時値を記録します。(瞬時値記録)
ON	1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録します。(統計値記録) (記録容量は15,000データとなります。)

**注記** 記録間隔が「1秒」設定の時は、「統計値記録」は選択できません。

## 省電力設定を設定する

省電力設定とは、約30秒間何も操作しないと表示が自動的に消える機能です。キー操作を行うと画面は再び点灯します。

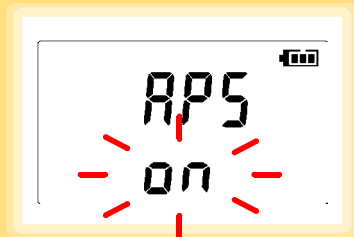

- 1 **設定**キーを押して、省電力設定画面を表示する。(表示部に **[APS]** 表示、設定が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、**[ON]**、または **[OFF]** を選択する。
- 3 **設定**キーを押して、設定を確定する。  
(測定レンジ画面に切り替わります)

設定内容	説明
ON (初期設定)	省電力設定をON (有効) にします。
OFF	省電力設定をOFF (無効) にします。(画面は常に点灯)

**注記** 省電力設定がON (有効) でもわずかな電池消耗があります。

参照: 「付録3 電池寿命の目安」(⇒ p. 付2)

## 測定レンジを設定する

測定する温度範囲に応じて、測定レンジ（表示分解能）を選択します。

- 1 **設定**キーを押して、CH1 レンジ設定画面を表示する。(表示部に [1]、[rng] 表示、設定が点滅)
- 2 **(+)**、または **(-)** キーを押して、[200.0°C]、または [800°C]、[OFF] を選択する。
- 3 **設定**キーを押して、設定を確認する。(CH2 レンジ設定画面に切り替わります)
- 4 同様に CH2 のレンジも設定する。
- 5 **設定**キーを押して、設定を確認する。(測定画面に切り替わります)

設定内容	説明
800°C (初期設定)	-40°C ~ 800°C の範囲を 1°C 分解能で表示
200.0°C	-40°C ~ 200.0°C の範囲を 0.1°C 分解能で表示
OFF	CH1 (または CH2) を使用しません。 ([OFF] を選択できるのは、CH1 と CH2 のどちらか一方のみです)

## 3.3 PC アプリで設定する


LR5091 通信アダプタ、または LR5092 データコレクタ付属の PC アプリ「LR5000 用 ユーティリティ」で本器の設定ができます。

あらかじめ、PC アプリをコンピュータにインストールしておいてください。(⇒ p.22)

### 本器、LR5091 通信アダプタ、コンピュータを接続する

付属の USB ケーブルでコンピュータに接続します。

用意するもの：本器、LR5091 通信アダプタ、USB ケーブル、コンピュータ

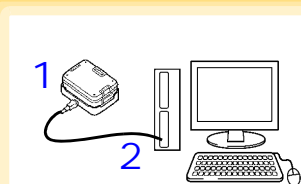

1 LR5091(または LR5092) の USB コネクタに USB ケーブルを差し込み、コンピュータの USB ポートに接続する。


2 本器を LR5091(または、LR5092) に接続する。

(赤外線ポート同士が重なるように、本器と LR5091(または LR5092) を接続します)

自動的にメイン画面が表示されます。  
(初期設定の場合)

データミニ内にデータがある場合は、取り込みを確認するダイアログが表示されます。  
【はい】をクリックすると、自動的にデータを取り込みます。(⇒ p.45)

### 本器の設定をする

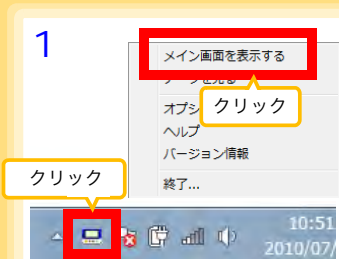


1 メイン画面が表示されない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、**【メイン画面を表示する】**をクリックする。

メイン画面が表示されます。



2

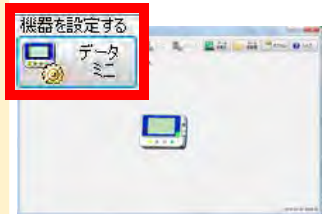


2 【機器を設定する】の【データミニ】ボタンをクリックする。

データミニ設定画面が表示されます。  
(データミニが接続されていない場合は、接続を促す画面が表示されます。データミニを接続してください)

3 機器の一覧\*から本器を選択して、設定内容を修正する。(⇒ p.36)

4 【設定を送信】ボタンをクリックする。

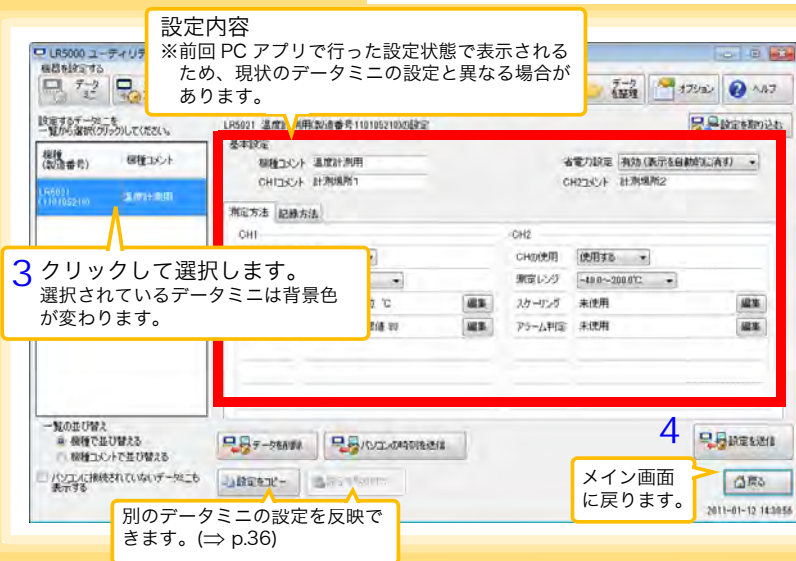

#### \*: 機器の一覧について

- コンピュータに接続されているデータミニ (最大 10 台) が表示されます。
- 【パソコンに接続されていないデータミニも表示する】をチェックすると、以前に設定を保存したデータミニ (未接続) も一覧に表示されます。
- 2 台以上が表示されている場合は、一覧の表示を昇順で並べ替えることができます。([一覧の並べ替え])




#### 現状のデータミニの設定を反映したいときは？

1. 画面右上の【設定を取り込む】ボタンをクリックする。  
(ダイアログが表示されます)
2. ダイアログの【パソコンに設定を取り込む】ボタンをクリックする。  
(設定内容に反映されます)

### ❓ 別のデータミニの設定を反映したいときは？

1. 設定をコピーしたいデータミニを機器の一覧から選択して、[設定をコピー] ボタンをクリックする。
2. 機器の一覧からコピーした設定を貼り付けるデータミニを選択して、[設定を貼り付け] ボタンをクリックする。  
(ダイアログが表示されます)
3. ダイアログの [貼り付け] ボタンをクリックする。  
(設定内容に反映されます)

### ❓ 設定内容の修正方法を詳しく知りたい！

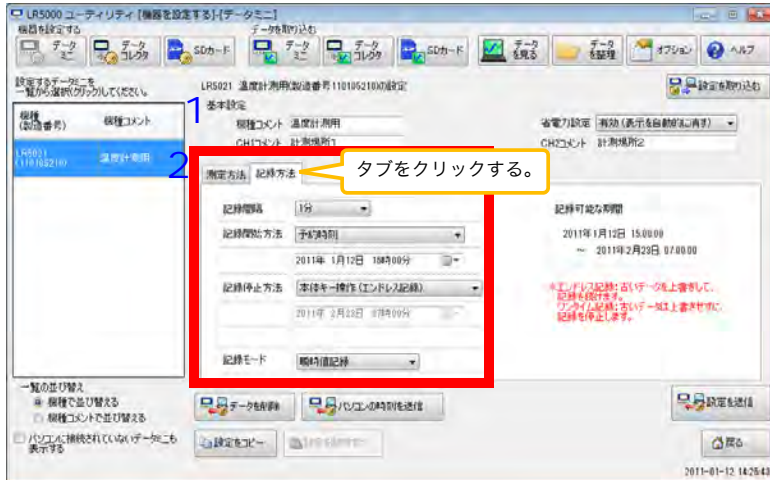

### 1 [基本設定] の内容を設定する。

機種コメント	必要に応じて、データミニを識別するためのコメントを入力します。
省電力設定	省電力設定 (⇒ p.32) の有効 (ON)、無効 (OFF) を設定します。 参照: 「付録 3 電池寿命の目安」 (⇒ p. 付 2)
CH1 コメント CH2 コメント	必要に応じて、測定チャンネルを識別するためのコメントを入力します。

※ コメント入力は最大全角 20 文字までです。  
また、次の文字は使用できません (¥、/、:、\*、?、"、<、>、|)。

### 2 [記録方法] タブの内容を設定する。

**注記** 省電力設定が ON (有効) でもわずかな電池消費があります。

## 記録間隔

記録間隔を選択します。

1/2/5/10/15/20/30秒、1/2 /5/10/15/20/30/60分

## 記録開始方法

記録開始方法を選択します。

**[予約時刻]** を選択した場合は、指定時刻(年月日時分)も設定します。

設定内容	説明
本体キー操作	データミニのキー操作で記録を開始します。
設定送信後すぐに記録開始	<b>[設定送信]</b> ボタンを押すと、記録を開始します。
予約時刻	<b>[設定送信]</b> ボタンを押すと、指定時刻から記録を開始します。
指定時刻の設定可能範囲	2010年1月1日00:00～2039年12月31日23:59

**注記** **[予約時刻]** を設定した場合、記録待機中(指定時刻までの間)はデータミニの表示部に **[REC]** マークが点滅します。

## 記録停止方法

記録停止方法を選択します。

**[予約時刻(エンドレス記録)]**、または **[予約時刻(ワнтаイム記録)]** を選択した場合は、指定時刻(年月日時分)も設定します。

設定内容	説明
本体キー操作 (エンドレス記録)	データミニのキー操作で記録を停止します。 メモリがいっぱいになると、古いデータから上書きします。
本体キー操作 (ワнтаイム記録)	データミニのキー操作で記録を停止します。 または、メモリがいっぱいになった時点で記録を停止します。
予約時刻 (エンドレス記録)	指定した時刻に記録を停止します。 メモリがいっぱいになると、古いデータから上書きします。
予約時刻 (ワнтаイム記録)	指定した時刻に記録を停止します。 または、メモリがいっぱいになった時点で記録を停止します。
予約時刻のデータを保持する	<b>[予約時刻(エンドレス記録)]</b> を設定した場合に指定します。 チェックすると、予約時刻のデータを記録してから停止します。

## 記録モード

記録モードを選択します。

設定内容	説明
瞬時値記録	記録間隔ごとの瞬時値を記録します。
統計値記録	1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録します。(記録容量は15,000データとなります。)

**参照** :統計値記録に設定すると、電池寿命は短くなります。「付録3 電池寿命の目安」(⇒ p.付2)

**注記** 記録間隔が「1秒」設定の時は、「統計値記録」は選択できません。

- 3 **[測定方法]** タブの内容を設定する。  
**[編集]** ボタンをクリックすると、設定ダイアログが表示されます。

**測定レンジの設定内容**

3 測定方法 **記録方法** タブをクリックする。 参照:「測定レンジを設定する」(⇒ p.33)

CH1	CH2
CHの使用: 使用する	CHの使用: 使用する
測定レンジ: -40.0~200.0°C	測定レンジ: -40.0~200.0°C
スケーリング: A=1 B=-0.2 単位 °C <span style="float: right;">[編集]</span>	スケーリング: 未使用 <span style="float: right;">[編集]</span>
アラーム判定: 上限値 120 下限値 80 <span style="float: right;">[編集]</span>	アラーム判定: 未使用 <span style="float: right;">[編集]</span>

データを削除 | パソコンの時刻を送信 | 設定を送信

設定をコピー | 設定を貼り付け | 戻る

### スケーリング (必要に応じて設定します) 参照:「スケーリングとは？」(⇒ p.40)

測定値に対して以下のスケーリング演算を行います。

スケーリング結果 = 元のデータ (測定値) × A + B × 補助単位

スケーリング結果は、データミニの画面に表示されます。

スケールリングの設定

スケールリング機能は、次の演算式でデータを加工します。  
 スケールリング結果 = 元のデータ(測定値) × A + B × 補助単位

スケールリング機能を使用する

係数A/Bの設定		単位の設定	
変換例で指定	ABを直接指定	補助単位	文字列
元のデータ	スケールリング結果	°C	
0.2 °C	0 °C		
50.4 °C	50 °C		

表示桁の設定  
 小数点位置を固定する

設定例  
 スケールリング後の表示を 0000kW (とする場合は、補助単位"K"、文字列" W"、小数点以下2桁固定)を設定します。  
 ※ 小数点位置を固定しない場合  
 スケールリング後の値によって、小数点位置が移動します。

設定の確認  
 元のデータ 50 °C → 計算 → スケールリング結果 49.6 °C

[取消/消し] [保存]

スケールリング機能を使用する  
 チェックするとスケールリングが有効になります。

#### 変換例で指定、AB を直接指定

タブをクリックすると設定内容が変わります。  
 どちらかのタブで設定すればOKです。  
 (設定はもう一方のタブに反映されます)

係数A/Bの設定

変換例で指定 | ABを直接指定

係数A(係数): 1 倍

係数B(オフセット): -0.2 °C

1. 下記の内容を設定する。

設定内容	説明
変換例で指定	2点の変換例を入力します。(最大10文字)
ABを直接指定	スケーリング演算式の係数(A, B)を入力します。(最大10文字)
単位の設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[補助単位]</b> を選択します。 (<b>[p]</b>)=1E-12、(<b>[n]</b>)=1E-9、(<b>[μ]</b>)=1E-6、(<b>[m]</b>)=1E-3、空欄=1E0、(<b>[k]</b>)=1E3、(<b>[M]</b>)=10E6、(<b>[G]</b>)=1E9、(<b>[T]</b>)=1E12)</li> <li>• <b>[文字列]</b> を入力します。スケーリング結果の単位として使用されます。 (最大5文字、¥、/、:、*、?、"、&lt;、&gt;、 は使用できません)</li> </ul>
表示桁の設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[小数点位置を固定する]</b> をチェックすると、<b>[小数点以下*桁]</b> で指定した桁で小数点を固定します。0～3桁が選択できます。 (例: 0桁の場合は0000、3桁の場合は0.000)</li> <li>• <b>[小数点位置を固定する]</b> をチェックしないと、4桁の数値(0.000～±9999)で表示し、必要に応じて小数点位置が移動します。</li> </ul>

2. 設定の確認をする。

設定の確認	正しくスケーリングできるか確認することができます。 元のデータに任意の数値を入力して、 <b>[計算]</b> ボタンをクリックすると、スケーリング結果が表示されます。
-------	---

3. **[保存]** ボタンをクリックする。

(スケーリングの設定が保存され、データミニ設定画面に戻ります)

※ **[取り消し]** ボタンをクリックすると、設定を保存せず、データミニ設定画面に戻ります。

### アラーム判定 (必要に応じて設定します)

上下限値を設定します。

測定値が設定した範囲から外れると、データミニの画面に **[AL]** マーク (アラームマーク) が表示されます。

設定後、**[保存]** ボタンをクリックして、設定を保存します。

(データミニ設定画面に戻ります)

※ **[取り消し]** ボタンをクリックすると、設定を保存せず、データミニ設定画面に戻ります。

※瞬時値記録では記録間隔ごとに、統計値記録では1秒ごとにアラーム判定します。

※アラーム判定は、LR5021表示部の表示値(4桁)よりも桁数の多い測定値で行います。

※測定値が測定範囲外(OF/UF表示)あるいはセンサの異常(---表示)時は **[AL]** マークが表示します。

## データミニ設定画面のその他の機能

## データを削除

選択しているデータミニの記録データを削除します。(接続しているデータミニのみ)

## パソコンの時刻を送信

選択しているデータミニの時計をコンピュータの時計に合わせます。(コンピュータの時計が正しいか確認してから送信してください)

設定をコピー、設定を貼り付け別のデータミニの設定を反映できます。(⇒ p.36)

\* オプション画面で **【データミニの設定画面に次の機能を追加する】** をチェックしている場合のみ表示されます。

設定を保存\*  
設定をコンピュータに保存します。ダイアログが表示されるので、保存先を指定、ファイル名を入力し、保存します。(ファイルの拡張子:.conf)

設定を開く\*  
コンピュータに保存されている設定を開きます。ダイアログが表示されるので、ファイルの場所とファイル名を指定して開きます。(ファイルの拡張子:.conf)


## スケーリングとは？

測定値を任意の値に調整して表示することを「スケーリング」といいます。本器の測定値と基準器の値の誤差を補正したいときなどに便利です。

例えば、本器と基準器で2ポイントの値がわかっている場合は、「変換例で指定」を選択します。

①本器が 0.2°C のとき基準器が 0.0°C、②本器が 50.4°C のとき基準器が 50.0°C

(スケーリング結果)

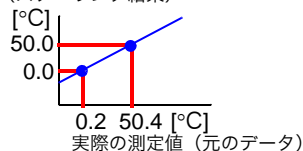


係数ABの設定		単位の設定	
変換例で指定		補助単位 文字列	
ABを直接指定		°C	
元のデータ	スケーリング結果	表示桁の設定	
0.2 °C	→ 0 °C	<input checked="" type="checkbox"/> 小数点位置を固定する	
50.4 °C	→ 50 °C	小数点以下 1 桁	

また、本器と基準器で1ポイントだけ値がわかっている場合は、「ABを直接指定」を選択します。

①本器が 0.2°C のとき基準器が 0.0°C

1ポイントだけ値がわかっている場合、傾きは「1」に設定し、オフセットのみ入力します。

[°C]

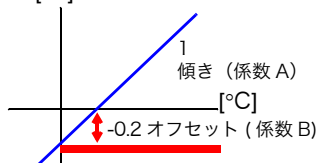


係数ABの設定		単位の設定	
変換例で指定		補助単位 文字列	
ABを直接指定		°C	
係数A(傾き)	1 倍	表示桁の設定	
係数B(オフセット)	-0.2 °C	<input checked="" type="checkbox"/> 小数点位置を固定する	
		小数点以下 1 桁	

## 測定・解析

## 第4章

## 4.1 測定前の点検

測定を開始する前に、下記事項を点検します。

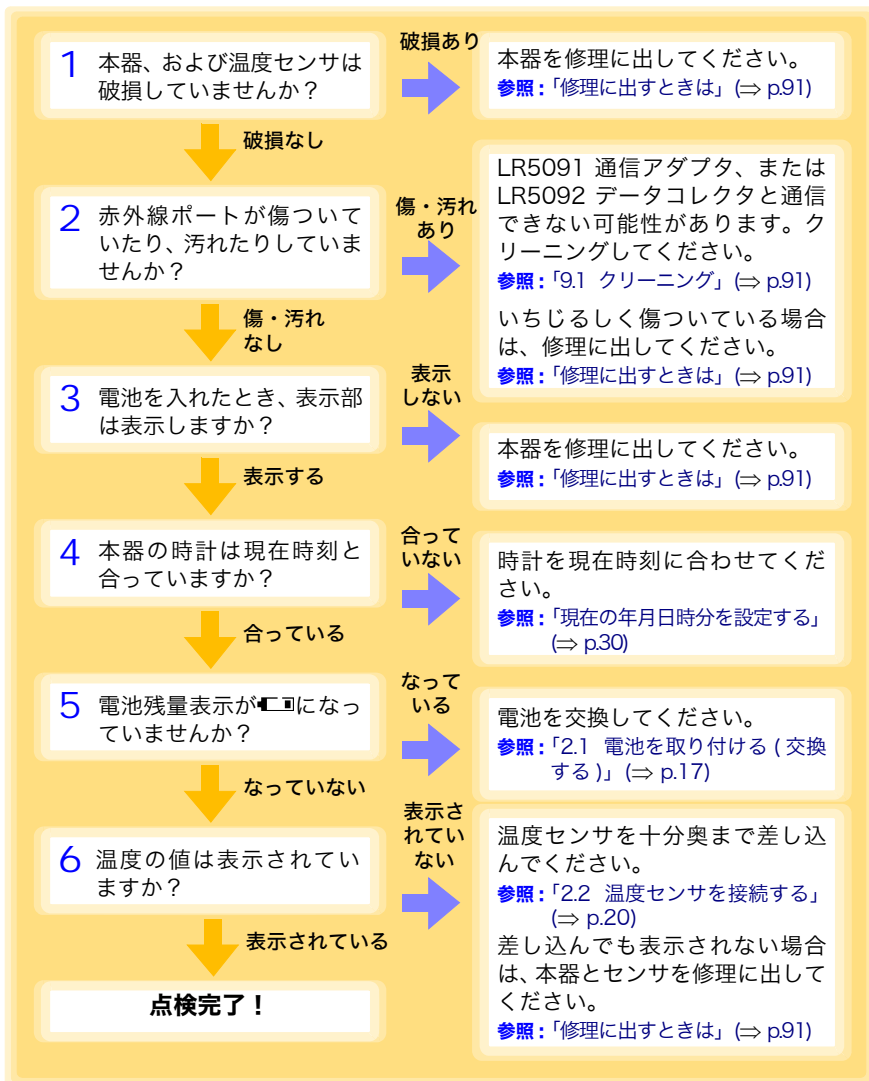

## 4.2 本器を設置する

点検が完了したら、本器を測定場所に設置します。  
 設置する前に、必ず「設置時の注意」(⇒ p.5)をよく読んでください。  
 必要に応じて、以下の方法で本器を設置します。

### ⚠ 警告


ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人は Z5004 マグネット付きストラップを使用しないでください。また、Z5004 を近づけることも大変危険ですのでおやめください。医療機器の正常な作動を損ない、人命にかかわる恐れがあります。

### 注記


- Z5004 に落下などによる衝撃を加えないでください。衝撃により欠け、割れが発生することがあります。
- Z5004に雨水やホコリなどがかかる場所、または結露が生じる場所での使用を避けてください。このような場所では磁石が腐食したり劣化することがあります。
- Z5004 をフロッピーディスク、磁気カード、プリペイドカード、切符などの磁気記録媒体に近づけると、データが破壊されて使用できなくなる恐れがあります。また、パソコン、テレビ画面、電子腕時計等の精密電子機器に近づけると故障の原因になる可能性があります。

### Z5004 マグネット付きストラップで壁などに取り付ける

用意するもの：Z5004 (オプション)



- 1 Z5004 をストラップ/スタンド取り付け穴に取り付ける。  
(a, b, c の順でストラップを通します)



- 2 磁石部分を壁面 (鉄板) などに付ける。



## 4.3 記録を開始・停止する

本器を設置したら、記録を開始します。

### 開始

### 停止

**開始** 測定画面を表示して、**記録 / 停止**キーを2秒以上押す。

**開始** [REC]、およびデータ数が点滅します。  
※ [REC] マークが点滅から点灯状態になるまでキーを押し続けてください。

点滅が止まると同時にデータ数が0になり、記録を開始します。

本体メモリには、2回分のデータが保持されます。(2回分のデータが保持されている状態で記録を開始すると、古いデータは消えますのでご注意ください)

1秒後に測定画面が表示されます。

**停止** 記録中([REC]点灯中)に**記録 / 停止**キーを2秒以上押す。

[REC] が点滅します。  
※ [REC] マークが点滅して消灯するまでキーを押し続けてください。

記録を停止しなくても、コンピュータへデータを取り込むことができます。  
**参照**：「4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する」(⇒ p.46)

[REC] が消灯すると同時に、記録が停止します。

停止方法が [OFF] (ワンタイム記録) に設定されている場合は、停止操作をする前にメモリがいっぱいになると、記録は停止します。(⇒ p.31)

**注記** 電池が消耗していると記録を開始できません。また、記録中に電池が消耗すると記録を停止します。


参照:「2.1 電池を取り付ける(交換する)」(⇒ p.17)

### 自動的に区切りの良い時刻で記録を開始します

記録間隔に応じて以下のタイミング(区切りの良い時刻)で記録を開始します。


記録間隔	記録タイミング(記録開始時刻)
1秒	00秒～59秒(1秒間隔)
2秒	00秒～58秒(2秒間隔)
5秒	00秒～55秒(5秒間隔)
10秒	00秒～50秒(10秒間隔)
15秒	00秒～45秒(15秒間隔)
20秒	00秒～40秒(20秒間隔)
30秒	00秒～30秒(30秒間隔)
1分	00分00秒～59分00秒(1分間隔)
2分	00分00秒～58分00秒(2分間隔)
5分	00分00秒～55分00秒(5分間隔)
10分	00分00秒～50分00秒(10分間隔)
15分	00分00秒～45分00秒(15分間隔)
20分	00分00秒～40分00秒(20分間隔)
30分	00分00秒～30分00秒(30分間隔)
60分	00時00分00秒～23時00分00秒(1時間間隔)

#### 例: 記録開始の操作を行った時刻が 12:01:00、記録間隔が 10 分の場合

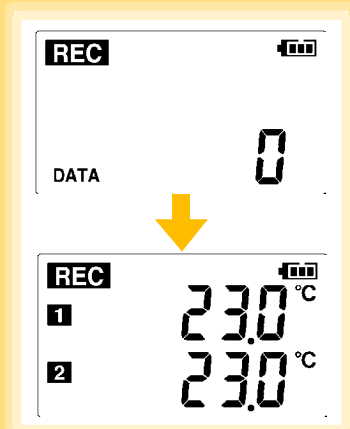

(12:01:00) 記録開始の操作を行った表示部に [REC] が点灯しますが、まだ記録は開始しません。

「12時開始のつもりが1分過ぎてしまった…」  
実際の記録開始時間は、区切りのよい12時10分に。



(12:10:00)  
記録を開始します。


瞬時値記録の場合はすぐにデータ数が1になります。

統計値記録の場合は、12:20:00にデータ数が1になります。

## 4.4 現在の測定値、記録データを確認する

はじめに、温度センサを被測定物に挿入 / 接触します。

- 注記**
- 9472-50, 9473-50 シース形温度プローブの測温部は金属シースの先端にあります。被測定物の内部温度を測定する場合、正確に測定するために金属シースの直径の15～20倍の長さを挿入してください。

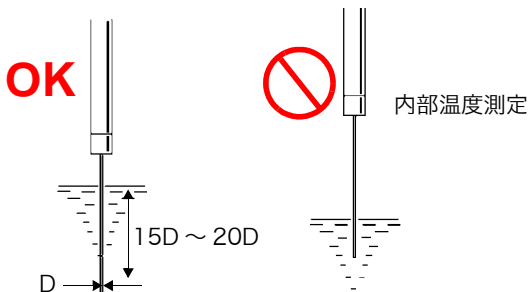

- 9476-50 表面形温度プローブで表面温度を測定する場合、正確に測定するために測温部を十分に接触させてください。



- 周囲温度が急激に変化する場所での使用は、基準接点補償が不安定になり測定誤差の原因となりますので、本体と温度センサを接続した状態で10～20分間使用環境に放置し、本体が周囲温度になじんでから測定を行ってください。

次に、測定画面 (⇒ p.14) を表示して、各記録データを確認します。  
現在の測定値 (瞬時値)、記録データ数、最大値、最小値が閲覧できます。  
(+) または (-) ボタンで、表示の切り替えができます。



### 設定画面から測定画面に切り替えたいときは？


設定画面で**記録 / 停止**キーを押すと、測定画面に切り替わります。

- 注記**
- 省電力設定 (⇒ p.32) をON(有効)に設定している場合、約30秒何も操作しないと、表示部は消灯します。測定値 (瞬時値)、各記録データを確認したいときは、任意のキーを押して測定画面を表示してください。
  - 現在の測定値 (瞬時値) 表示時は、記録間隔の設定に関わらず、約1秒ごとに測定値を更新します。

## 4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する

データミニに記録されている記録データを、コンピュータへ取り込み (保存) します。PC アプリを使用するので、あらかじめ、インストールしておいてください。(⇒ p.22)


用意するもの : 本器、LR5091 通信アダプタ (または LR5092 データコレクタ)、USB ケーブル、コンピュータ



- 1 LR5091 (または LR5092) の USB コネクタに USB ケーブルを差し込み、コンピュータの USB ポートに接続する。
- 2 本器を LR5091 (または LR5092) に接続する。  
(赤外線ポート同士が重なるように、本器と LR5091 (または LR5092) を接続します)


自動的にメイン画面が表示されます。  
未収集のデータがあると、取り込みを確認するダイアログが表示されます。

- 3 **【はい】** をクリックする。

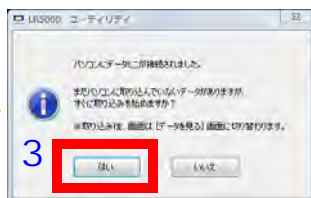


次ページへ続く

## 4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む(保存する)、グラフ表示する

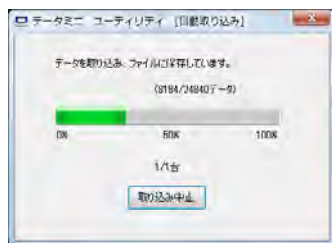

自動的に本器の記録データをコンピュータへ取り込みます。取り込んだデータは、ファイルに保存されます。(自動取り込み)

※初期設定の場合(オプション画面の【パソコンにデータミニが接続されたら自動的にデータを取り込み、ファイルに保存する】が有効)(⇒ p.80)

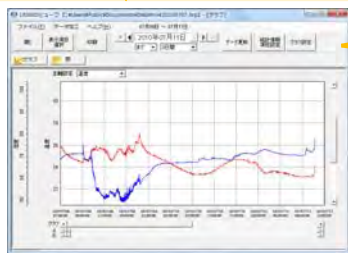

ビューワが起動して、グラフが表示されます。(自動グラフ表示)

※初期設定の場合(オプション画面の【データを取り込んだら、自動的にグラフを表示する】が有効)(⇒ p.80)



### 記録データの保存は？

記録データをコンピュータへ取り込むと、自動的に保存されます。保存先、ファイル名はオプション画面の保存先の基本設定に従います。

## ビューワの画面構成

ビューワの画面構成を示します。

記録データが保存されているファイルを開きます。

表示する項目を選択できます。(⇒ p.55)

表示しているグラフ / 表を印刷できます。(⇒ p.61)

表示する期間を指定できます。

記録ファイルを再読み込みして更新します。

参照: 「メニューバーの項目内容」(⇒ p.49)

グラフ表示時に [統計情報・項目設定] ダイアログを表示します。(⇒ p.53)

グラフ表示時に [グラフ設定] ダイアログを表示します。(⇒ p.51)

クリックすると、グラフ / 表を切り換えます。

グラフ / 表が表示されます。

The screenshot shows a software window titled "LR5000ビューワ" with a file path "C:\Users\public\Documents\DataMini#2\100707.hrp2 - [グラフ]". The window contains a menu bar with "ファイル(F)", "データ加工", and "ヘルプ(H)". Below the menu bar is a toolbar with buttons for "開く", "表示項目選択", "印刷", "データ更新", "統計情報項目設定", and "グラフ設定". A date range selector shows "2010年07月11日" and "3日間". The main area has a "グラフ" button and a "表" button. Below these is a graph with a y-axis labeled "記録時間" (50-80) and an x-axis with dates from 10/07/09 to 10/07/11. A table below the graph shows columns "グラフ" and "A", "B".


## 4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する

## メニューバーの項目内容

メニュー	項目	内容
ファイル	開く	記録データが保存されているファイルを開きます。
	最近開いた記録ファイル	最近開いたファイルを開きます。
	名前を付けて記録ファイルを保存	現在表示しているデータを、新しい記録ファイルに保存します。
	グラフ印刷	データをグラフ形式で印刷します。(⇒ p.61)
	Microsoft Excel に貼り付け	表示されているデータを Microsoft Excel に貼り付けます。
	CSV ファイルに出力	表示されているデータを CSV ファイルに出力します。
	終了	PC アプリを終了します。
データ加工	スケーリング	1 つのチャンネルのデータにスケーリング処理を行います。(⇒ p.65)
	電力演算	簡易的に電力を計算します。(⇒ p.66)
	電気料金計算	簡易的に電気料金を計算します。(⇒ p.67)
	稼働率計算	簡易的に稼働率を計算します。(⇒ p.68)
	積算	データを積算します。(⇒ p.69)
	露点温度計算	露点温度を計算します。(⇒ p.70)
	項目間演算	2 つの項目のデータを使用して、簡単な演算を行います。(⇒ p.71)
ヘルプ	OVER データ修正	上下限値から外れたデータを、指定された値に変換して、新しい項目に保存します。(⇒ p.72)
	ヘルプ	ヘルプファイルを表示します。
	バージョン情報	PC アプリのバージョン情報を表示します。


## グラフの主な機能

グラフの主な機能を示します。

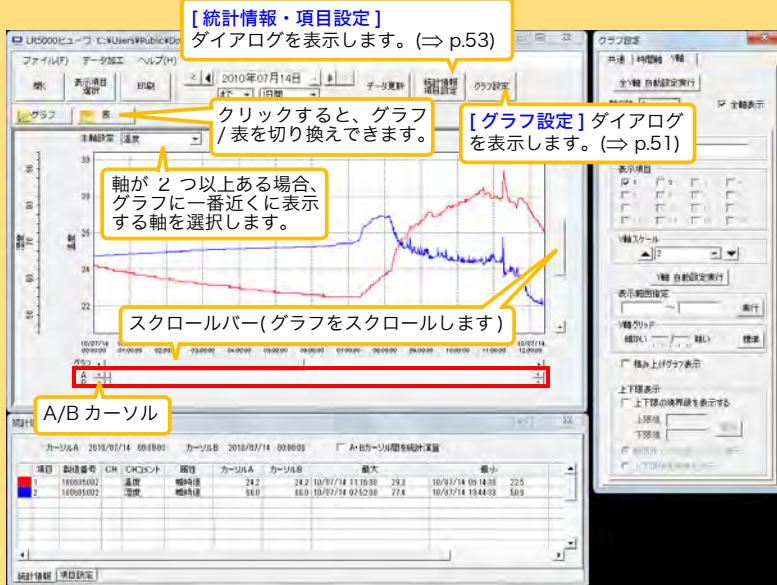

### 🔍 グラフを拡大したいときは？

- 1 拡大したい領域をドラッグして、ボックスカーソルで囲む。
- 2 右クリックでポップアップメニューを開き、**[選択範囲拡大]**をクリックする。

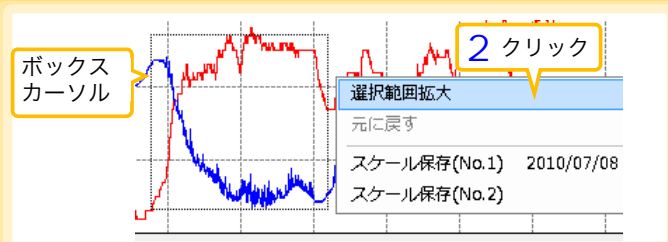

### 🔍 グラフの線色・表示の ON/OFF を変更したいときは？

**[統計情報・項目設定]** ダイアログの **[項目設定]** タブで変更できます。(⇒ p.53)

### 🔍 グラフの詳細を設定したいときは？

**[グラフ設定]** ダイアログで詳細設定できます。(⇒ p.51)




## 4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する

## 【グラフ設定】ダイアログ


グラフの詳細を設定できます。各タブをクリックして、項目を設定します。

## 【共通】タブ



- 1 時間軸と Y 軸を自動的に最適なスケールに設定します。
- 2 グリッドの表示 / 非表示を切り替えます。
- 3 グラフの背景色を変更します。
- 4 グラフをクリップボードにコピーします。Word 文書などにグラフを貼り付けることができます。

## 【時間軸】タブ

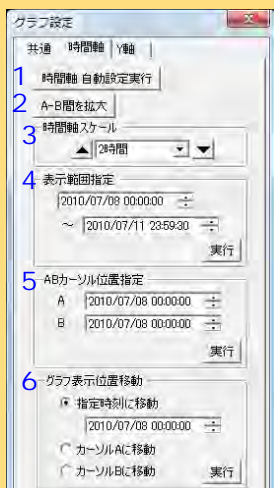

- 1 時間軸を自動的に適切なスケールに設定します。
- 2 A/B カーソル間を拡大表示します。
- 3 時間軸のスケールを変更します。
- 4 時間軸方向の表示範囲を指定します。【実行】をクリックすると、設定が反映されません。
- 5 カーソル位置を指定します。【実行】をクリックすると、設定が反映されます。
- 6 グラフの表示開始位置を指定します。【実行】をクリックすると、設定が反映されません。

## [Y 軸] タブ



- 1 全 Y 軸を自動的に適切なスケールに設定します。
- 2 Y 軸を各項目ごとに分けたい場合は、軸の数を 1 以外に設定します。軸は表示している項目の数 (最大で 16 個) まで設定できます。
- 3 すべての軸を表示します。
- 4 各軸に対してコメントを設定できます。
- 5 各軸を使用する項目を設定します。
- 6 各軸の Y 軸スケールを設定します。
- 7 現在設定している Y 軸を自動的に適切なスケールに設定します。
- 8 Y 軸の表示範囲を指定します。【実行】をクリックすると、設定が反映されます。
- 9 Y 軸グリッドの間隔を設定します。
- 10 【表示項目】で選択した項目を、積み上げグラフで表示します。
- 11 グラフ上に上下限を示す実線で、または範囲外エリアを塗りつぶして表示できます。

## 【統計情報・項目設定】ダイアログ

【統計情報】タブでは、以下の項目が確認できます。

- ・ 項目番号
- ・ 製造番号
- ・ チャンネル番号
- ・ チャンネルコメント
- ・ 属性 (測定値の種類)
- ・ A/B カーソル位置の測定値
- ・ 統計データ
- ・ 単位

## 【統計】タブ

A/B カーソル位置の時刻

チェックすると、A/B カーソル間の最大値、最小値、平均値、および積算値の演算を行い、表示します。積算値は、積算系の項目の場合のみ表示されます。

項目	製造番号	CH	CHコメント	属性	カーソルA	カーソルB	最大	最小
1	100605002		温度	瞬時値	24.2	24.2 10/07/14 11:16:30	29.3	10/07/14 06:14:30 22.5
2	100605002		湿度	瞬時値	66.0	66.0 10/07/14 07:52:00	77.4	10/07/14 13:44:30 50.9

【項目設定】タブでは、以下の項目を変更できます。

- ・ 表示の ON/OFF
- ・ グラフの線色、太さ
- ・ 棒グラフ表示の ON/OFF

## 【項目設定】タブ

表示の有効/無効	色	線の太さ	項目	測定項目	棒グラフ表示
<input checked="" type="checkbox"/>	■	1	1	温度	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	■	1	2	湿度	<input type="checkbox"/>

## 表の主な機能

「表」の主な機能を示します。

項目番号、製造番号、機種コメント、CHコメント、属性、単位、および全データの平均値、最大値、最小値、積算値が表示されます。

マウスで、最大値または最小値の数値をダブルクリックすると、該当するセルへジャンプします。(複数ある場合は先頭のセル)

記録時刻

記録値  
最小値は青、最大値は赤で表示されます。

項目番号	製造番号	機種コメント	CHコメント	属性	単位	平均	最大	最小	積算
	100605002	5階フロア温度	5階フロア温度	温度	°C	24.7	29.9	22.5	40830.8
	100605002	5階フロア温度	5階フロア温度	温度	°C	65.7	77.4	50.9	108833.8
10/07/14 00:00:30						24.2	24.2	24.2	66.0
10/07/14 00:01:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:01:30						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:02:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:02:30						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:03:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:03:30						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:04:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:04:30						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:05:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:05:30						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:06:00						24.2	24.2	24.2	66.1
10/07/14 00:06:30						24.2	24.2	24.2	66.1

## 表の便利な機能

次のキー操作で、表のスクロールや、クリップボードへのデータのコピーが行えます。

項目	内容
<b>Ctrl</b> キーと <b>Home</b> キーを同時に押す	表の左上隅に移動します。
<b>Ctrl</b> キーと <b>End</b> キーを同時に押す	表の右下端に移動します。
<b>Home</b> キー	表の左端が見える状態にスクロールします。
<b>End</b> キー	表の右端にスクロールします。
<b>Ctrl</b> キーと <b>C</b> キーを同時に押す	現在選択されているセルの値を、クリップボードにコピーします。

## 表示する項目を選択する

ビューワの [表示項目選択] ボタンをクリックすると、表示する項目を選択する [表示項目選択画面] が表示されます。

1 表示したい項目をチェックする。  
(最大 600 項目チェックできます)

2 [OK] ボタンをクリックする。

## メニューバーの項目内容

メニュー	項目	内容	
項目の選択	選択範囲の項目にチェックを入れる	マウスで複数選択した項目 (青色表示) のチェックを追加 / 解除します。	
	選択項目のチェックを解除する		
	全項目にチェックを入れる	リスト上の項目が 600 項目以下の場合、すべての項目をチェック / チェック解除できます。	
	全項目のチェックを解除する		
	瞬時値に全てチェックを入れる		同じ属性の項目をすべてチェックします。 (その属性の項目が 600 項目以下の場合)
	最大値に全てチェックを入れる		
最小値に全てチェックを入れる			
平均値に全てチェックを入れる			
項目の並び替え	機種で並び替える	機種、製造番号、機種コメントごとに並び替えます。	
	製造番号で並び替える		
	機種コメントで並び替える		
	選択項目を上へ Alt+Up	マウスで選択した項目 (青色表示) を上下に移動します。	
	選択項目を下へ Alt+Down		
初期化	元の順番に戻します。		

## 4.6 手動で記録データをコンピュータへ取り込む（保存する）、グラフ表示する

手動で記録データをコンピュータへ取り込み（保存）して、グラフ表示します。




- 1 PC アプリが起動していない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、**[メイン画面を表示する]**をクリックする。

メイン画面が表示されます。

- 2 **[データを取り込む]**の**[データミニ]**ボタンをクリックする。

データ取り込み画面が表示されます。  
(データミニが接続されていない場合は、接続を促す画面が表示されます。データミニを接続してください)

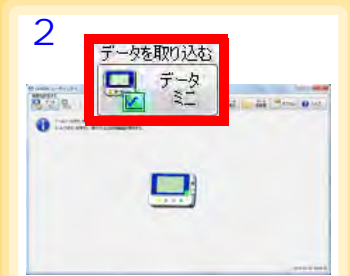

- 3 機器の一覧から本器を選択して、**[取り込み開始]**ボタン（または**[次へ]**ボタン）をクリックする。

\*: オプション画面の**[データ取り込み前にフォルダとファイルを毎回指定する]**が有効の場合 (⇒ p.80)

(**[取り込み開始]**ボタンをクリックした場合) データを取り込みます。(「データ取り込み後の画面」(⇒ p.58))

(**[次へ]**ボタンをクリックした場合) 保存方法選択画面が表示されます。(⇒ p.57)

3 クリックして選択  
選択されているデータミニは背景色が変わります。

2台以上が表示されている場合は、一覧の表示を昇順で並べ替えできます。

参照：P.58

3

メイン画面に戻ります。

機種	機種コメント	CH1	CH2
LR5000		計測場所3	計測場所4
		単位	℃
		記録時間	1分
			14:50:19 ~ 2011-01-12 14:50:55
			520回

## 4.6 手で記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する

LR5000 ユーティリティ < [データを取り込む] < [データミニ]

機器を設定する

データを取り込む

データミニは保存されているデータもパソコンに取り込みます。  
 一覧に、パソコンに接続されているデータミニの情報が表示されます。  
 データを取り込みたいデータミニをパソコンに接続して、一覧から選択してください。選択したら、[取り込み開始]をクリックしてください。

データミニ	CH1	CH2
CHコメント	計測場所3	計測場所4
単位	℃	℃
記録間隔	1秒	
記録期間	2011-01-12 14:56:19~2011-01-12 14:58:55	
測定回数	523回	

データミニに保存されているパソコンに未収録の前回のデータの情報を

データミニ	CH1	CH2
CHコメント	計測場所3	計測場所4
単位	℃	℃
記録間隔	1秒	
記録期間	2011-01-12 14:57:48~2011-01-12 14:58:49	
測定回数	722回	

取り込むデータの選択

- 最新のデータのみ取り込む
- 前回のデータのみ取り込む
- 両方のデータを取り込む

一覧の並び替え

取り込み開始

戻る

2011-01-12 15:09:24

前回のデータが取り込まれていない場合は、最新データと一緒に情報が表示されます。  
 [取り込むデータの選択] を選択してから [取り込み開始] ボタン (または [次へ] ボタン) をクリックします。

## 保存方法選択画面

LR5000 ユーティリティ < [データを取り込む] < [データミニ]

機器を設定する

データを取り込む

4 保存方法を設定  
3種類の方法があります。

その1  
保存先の基本設定を編集する。  
※オプション画面の設定 (⇒ p.80) も更新されます。

その2  
既存のファイルを指定する。\*

その3  
ファイル名の付け方、保存先フォルダを指定する。\*

保存先フォルダ C:\Users\Public\Documents\DataMini

ファイル名を指定する

ファイル名の付け方を指定する

参照: P.58

5 クリック

\* 同じ本体のデータがある場合、記録を停止していないデータは追記、停止したデータは別の項目に保存します。



## 自動取り込みにしたいときは？

オプション画面で [パソコンにデータミニが接続されたら自動的にデータを取り込み、ファイルに保存する] を有効にします。(⇒ p.80)



**データミニ内の全データを取り込みたいときは？**

**[データミニ内の全データを取り込みなおす]** をチェックする。  
 (コンピュータに保存されているデータも含め、データミニ内の全データを取り込みます。重複しているデータは上書き保存されます)


**データ取り込み画面 (⇒ p.56)**



**データを取り込んだ後、自動的にグラフを表示したいときは？**

**[データを取り込んだら、自動的にグラフを表示する]** をチェックする。  
 (チェックなしの場合は、取り込み終了後の画面に保存したファイルの一覧が表示されます)

**保存方法選択画面 (⇒ p.57)**



### データ取り込み後の画面

データの取り込みが終了しました。

取得したデータを見る  
 ファイルの保存先フォルダ  
 C:\Users\whok\Documents\DataMini

ファイル名  
 20110112

データの種類	CH1	CH2
CHコメント	計測場所3	計測場所4
単位	℃	℃
記録間隔	(仮)	
記録期間	2011-01-12	
測定回数		

データを操作する  
 右側に表示、データを取り込んだデータミニの操作を行う場合は、右のボタンをクリックしてください。

クリックすると、グラフを表示します。  
 (表示項目が16以上ある場合は、表示項目選択画面が表示されます。グラフ表示したい項目を選択します。(⇒ p.55))

クリックすると、表を表示します。

データミニ設定画面が表示されます。


メイン画面に戻ります。

データ取り込み画面 (⇒ p.56) が表示されます。




## 4.7 保存済みの記録データをグラフ表示する

保存してある記録データを PC アプリでグラフ表示します。

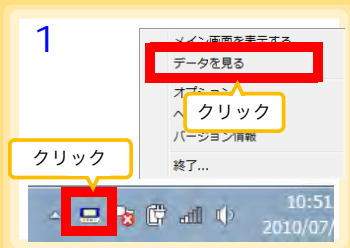

\*: PC アプリが起動している場合は、メイン画面の【データを見る】をクリックします。



- 1 PC アプリが起動していない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、【データを見る】をクリックする。\*

データを見る画面が表示されます。

【最新データを見る】タブの一覧に、コンピュータに保存されているデータミニが表示されます。


- 2 一覧から本器を選択する。

最新データの情報が表示されます。

- 3 【グラフを表示】ボタンをクリックする。

ビューワが起動して、グラフが表示されます。(⇒ p.48)

(表示項目が 16 以上ある場合は、表示項目選択画面が表示されます。グラフ表示したい項目を選択します。(⇒ p.55))

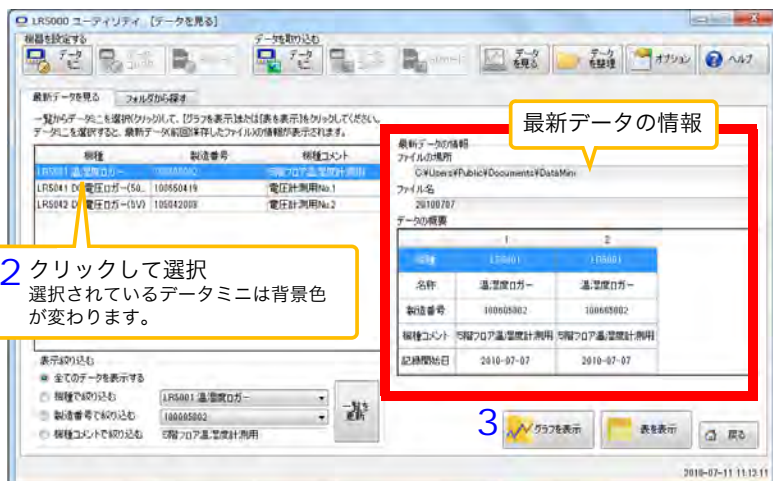

## データを見る画面のその他の機能

表示絞り込む

全てのデータを表示する

機種で絞り込む

機種番号で絞り込む

機種コメントで絞り込む

機種コメントで絞り込む

機種: LRS001 温度湿度計用

機種番号: 100605002

機種コメント: 5階フロア温度湿度計用

機種コメント: 5階フロア温度湿度計用

記録開始日: 2010-07-07

記録終了日: 2010-07-07

一覧を更新

グラフを表示

表を表示

## 表示を絞り込む

一覧に表示するデータミニを絞り込むことができます。条件を設定して【一覧を更新】ボタンをクリックします。  
※【機種コメントで絞り込む】に入力できる文字は最大20文字です。

## 表を表示

ビューが開き、取り込んだデータ（または選択したデータ）の表を表示します。



## 過去のデータが見たいときは？

【フォルダから探す】タブをクリックすると、フォルダおよびファイル名を指定して表示できます。

1 クリック

2 ドライブを選択

3 フォルダを選択

4 ファイルを選択

最近開いたフォルダ  
過去にグラフ、または表を表示したことのあるデータのフォルダが表示されます(最新10件)。


機種	1	2	3	4	5
名称	DO電圧計付 -50V	温度湿度計付	温度湿度計付	DO電圧計付 -50V	温度湿度計付
製造番号	105942008	100000002	100000002	105942008	100000002
機種コメント	LRS042	5階フロア温度湿度計用	LRS042	5階フロア温度湿度計用	5階フロア温度湿度計用
記録開始日	2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07	2010-07-07

## 4.8 記録データを印刷する

保存した記録データを、グラフで印刷できます。(グラフ印刷は、A3, A4, B4 サイズの用紙に対応しています) PC アプリを使用します。

グラフを表示した状態で、**[印刷]** ボタンをクリックします。

参照: グラフの表示方法: 「4.5」 (⇒ p.46)、 「4.6」 (⇒ p.56)、 または 「4.7」 (⇒ p.59)




**グラフの一部を印刷したいときは?**

表示する期間を指定してから **[印刷]** ボタンを押します。表示されていない箇所は印刷しません。

参照: 「ビューアの画面構成」 (⇒ p.48)


### グラフの印刷例

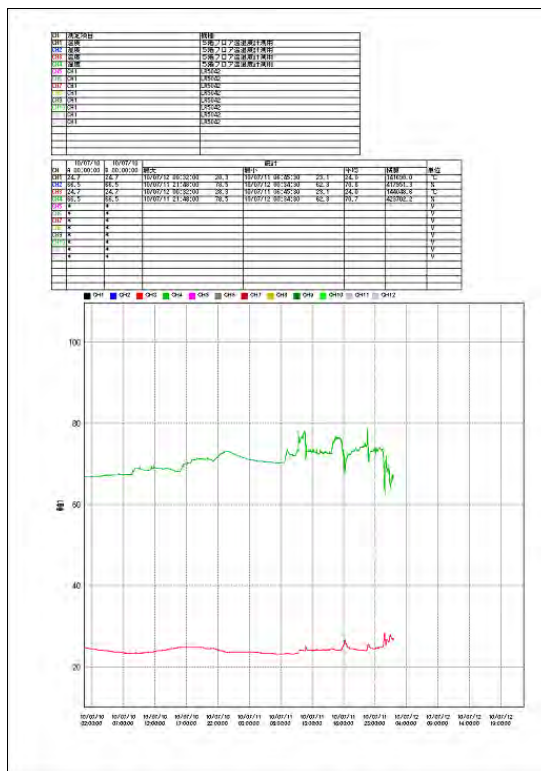




# 記録データを加工する 第5章

コンピュータへ取り込んだ記録データを加工（スケーリング、電力演算、電気料金演算、稼働率計算、積算、露点温度計算、項目間演算、OVER データ修正）できます。PC アプリを使用します。

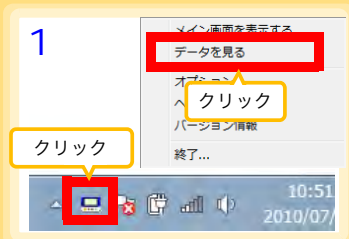

\*: PC アプリが起動している場合は、メイン画面の **[データを見る]** をクリックします。



- 1 PC アプリが起動していない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、**[データを見る]** をクリックする。

データを見る画面が表示されます。

**[最新データを見る]** タブの一覧に、コンピュータに保存されているデータミニが表示されます。

- 2 一覧から本器を選択する。

最新データの情報が表示されます。

- 3 **[グラフを表示]** ボタンをクリックする。

ビューワが起動して、グラフが表示されます。  
(表示項目が 16 以上ある場合は、表示項目選択画面が表示されます。データ加工したい項目を選択します。(⇒ p.55))

最新データの情報


機種	LR5001	LR5002
名称	温度湿度ロガー	温度湿度ロガー
製造番号	100603002	100603002
機種コメント	空調フロア温度計測用	空調フロア温度計測用
記録開始日	2010-07-07	2010-07-07

2 クリックして選択  
選択されているデータミニは背景色が変わります。

3 **[グラフを表示]**

次ページへ続く⇒

#### 4 メニューバーの [ データ加工 ] をクリックして、項目を選択する。

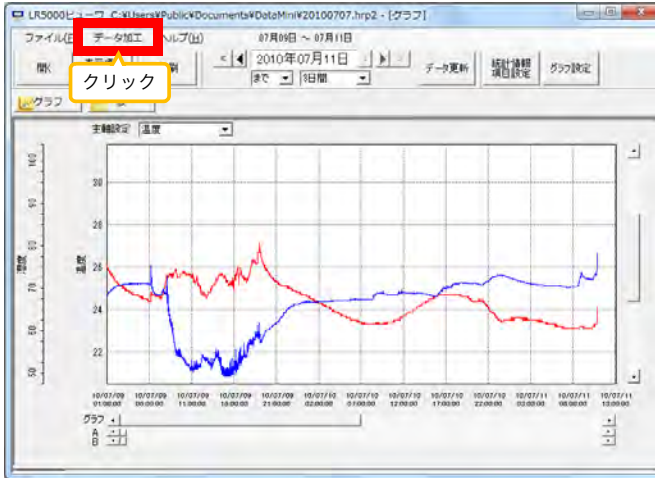

#### 【データ加工】の項目内容

項目	内容	参照箇所
スケーリング	1つのチャンネルのデータにスケーリング処理を行います。	(⇒ p.65)
電力演算	簡易的に電力を計算します。	(⇒ p.66)
電気料金演算	簡易的に電気料金を計算します。	(⇒ p.67)
稼働率計算	簡易的に稼働率を計算します。	(⇒ p.68)
積算	表示しているデータを積算します。	(⇒ p.69)
露点温度計算	露点温度を計算します。	(⇒ p.70)
項目間演算	2つの項目のデータを使用して、簡単な演算を行います。	(⇒ p.71)
OVER データ修正	上下限值から外れたデータを、指定された値に変換して、新しい項目に保存します。	(⇒ p.72)

## 5.1 スケーリングする

測定値に対して以下のスケーリング演算を行います。

スケーリング結果 = 元のデータ (測定値) × A + B × 補助単位

スケーリング結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。

測定項目と範囲の設定  
スケーリングしたい項目と期間を設定します。

変換例で指定、ABを直接指定  
タブをクリックすると設定内容が変わります。  
どちらかのタブで設定すればOKです。  
(設定はもう一方のタブに反映されます)

1. 項目と範囲の設定、および下記の内容を設定する。

設定内容	説明
変換例で指定*	2点の変換例を入力します。(最大10文字)
ABを直接指定*	スケーリング演算式の係数(A, B)を入力します。(最大10文字)
単位の設定	<ul style="list-style-type: none"> <li>【補助単位】を選択します。 ([p]=1E-12、[n]=1E-9、[μ]=1E-6、[m]=1E-3、空欄=1E0、[k]=10E3、[M]=1E6、[G]=1E9、[T]=1E12)</li> <li>文字列を入力します。スケーリング結果の単位として使用されます。(最大5文字、¥、/、:、*、?、"、&lt;、&gt;、 は使用できません)</li> </ul>

\*: どちらか一方を設定します。

2. 設定の確認をする。

設定の確認	正しくスケーリングできるか確認することができます。 元のデータに任意の数値を入力して、【計算】ボタンをクリックすると、スケーリング結果が表示されます。
-------	--

3. 【実行】ボタンをクリックする。

(スケーリング結果が保存されます)

※【終了】ボタンをクリックすると、【スケーリング】ダイアログを閉じます。

## 5.2 電力を演算する

クランプログガーの電流測定データについて、簡易的に電力を計算します。演算結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。

- 注記**
- 電力演算はあくまでも簡易的なものですので、計算結果が本当の電力値であるとは限りません。正確な電力測定には電力計をご使用ください。
  - 電流値に指定された項目のデータが、電流値であるかどうかの確認は行いません。データの種類に関係なく計算します。

**1 測定項目と範囲の設定**

測定項目と範囲の設定  
2つの電流測定値と演算する期間を設定します。

**2 電圧・力率・単位の設定**

使用する演算式  
【電力の種類】  
【单相2線】/【单相3線】/【3相3線】を選択すると、その種類にあった演算式で計算します。

**3**

- 項目と範囲の設定、および使用する演算式を設定する。
- 電圧・力率・単位を設定する。
  - この設定を保存したいときは、**【登録】** ボタンを押します。
  - 登録済みの設定を反映したいときは、その設定 (上画面の場合は **【設定 1】**) をダブルクリックします。
  - 設定を削除したいときは、その設定をクリックしてから **【削除】** ボタンをクリックします。
- 【実行】** ボタンをクリックする。  
(演算結果が保存されます)  
※ **【終了】** ボタンをクリックすると、**【電力演算】** ダイアログを閉じます。



## 5.3 電気料金を計算する

クランプログャーの電流測定データについて、簡易的に電気料金を計算します。

- 注記**
- 電気料金計算はあくまでも簡易的なものですので、計算結果が本当の電気料金であるとは限りません。
  - 電力値に指定された項目のデータが、電力値であるかどうかの確認は行いません。データの種類に関係なく計算します。


1. 項目と範囲を設定する。
2. 電気料金、電圧、力率を設定する。
3. **[計算]** ボタンをクリックする。  
(計算結果 (電力量と電気料金) が表示されます)  
※ **[終了]** ボタンをクリックすると、**[電気料金演算]** ダイアログを閉じます。

## 5.4 稼働率を計算する

測定値から簡易的に稼働率を計算します。

稼働率は、[上限値] よりも大きいデータの延べ時間を稼働時間と判定して、計算範囲の全区間と稼働時間の比率で計算します。

**例：機器の消費電流が 20 A 以上だった時間を稼働時間と判定する場合**

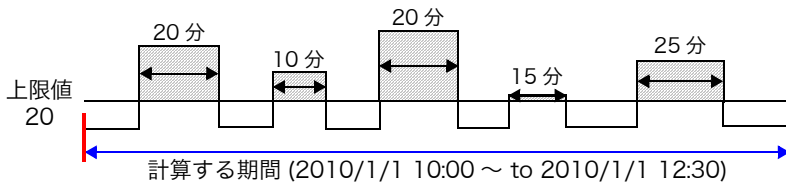

⇔ の合計が稼働時間となります。(上図の場合だと、稼働時間は 1.5 時間)

稼働時間 (1.5 時間) ÷ 計算する期間 (2.5 時間) × 100 = 稼働率 60%




### 測定項目と範囲の設定

稼働率を計算したい項目と期間を設定します。  
あらかじめグラフの A/B カーソル (⇒ p.50) で期間を指定してから、[AB カーソル間を計算] をチェックする方法もあります。

1. 項目と範囲を設定する。
2. 上限値を設定する。
3. [計算] ボタンをクリックする。  
(計算結果 (稼働時間と稼働率) が表示されます)  
※ [終了] ボタンをクリックすると、[稼働率計算] ダイアログを閉じます。

## 5.5 積算する

測定データを、指定された期間で積算していきます。  
積算結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。

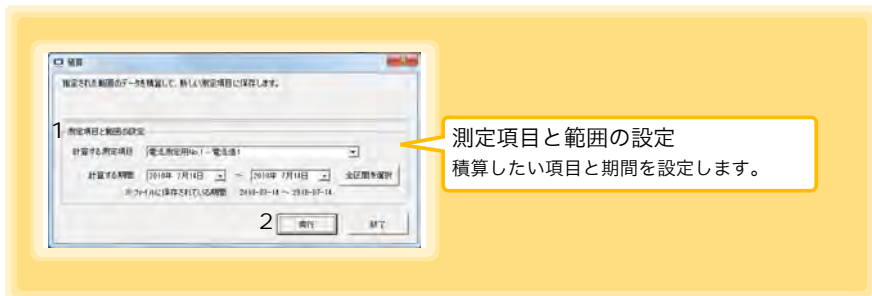


1. 項目と範囲を設定する。
2. **[実行]** ボタンをクリックする。  
(積算結果が保存されます)  
※ **[終了]** ボタンをクリックすると、**[積算]** ダイアログを閉じます。

## 5.6 露点温度を計算する

温湿度ロガーの温湿度測定データを基に、露点温度を計算します。  
計算結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。

- 注記**
- 計算に使用する項目が、温度又は湿度であるかどうかの確認は行いません。データの種類に関係なく露点温度を計算します。
  - 温度と湿度に指定された各データのうち、記録時刻が一致するデータのみ計算して保存します。
  - 演算元のデータの有効範囲は、温度用が -100 ~ 100、湿度用が 0 ~ 100 です。この範囲を超える値は、有効範囲の最小値または最大値に置き換えて演算します。

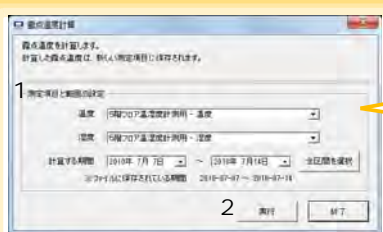


測定項目と範囲の設定  
温度値と湿度値と計算する期間を設定します。

1. 項目と範囲を設定する。
2. **[実行]** ボタンをクリックする。  
(計算結果が保存されます)  
※ **[終了]** ボタンをクリックすると、**[露点温度計算]** ダイアログを閉じます。

## 5.7 2つの項目を使用して演算する

2つの項目に対して簡単な演算(+-×÷)を行います。  
演算結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。


**注記** 項目1、項目2に指定された各データのうち、記録時刻が一致するデータのみ計算して保存します。

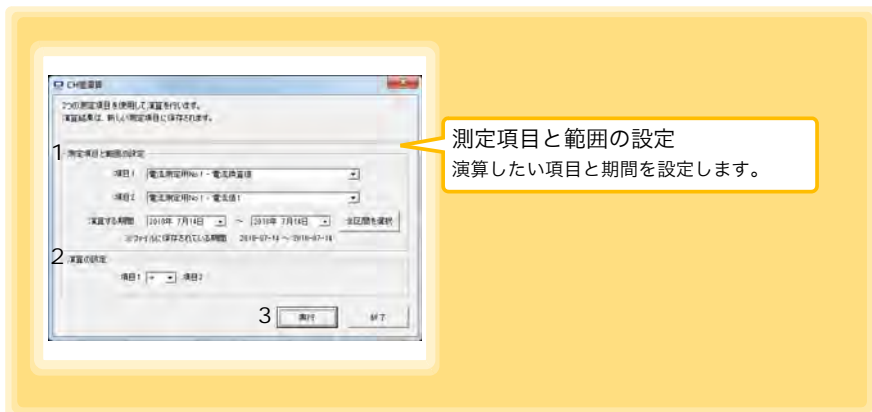

1. 項目と範囲を設定する。
2. 演算式を選択する。
3. **[実行]** ボタンをクリックする。  
(演算結果が保存されます)  
※ **[終了]** ボタンをクリックすると、**[項目間演算]** ダイアログを閉じます。

## 5.8 上下限值から外れたデータを指定した値に変換する

上限値より大きいデータと下限値より小さいデータを、指定された値に変換します。変換結果は、新しい項目として記録ファイルに保存されます。

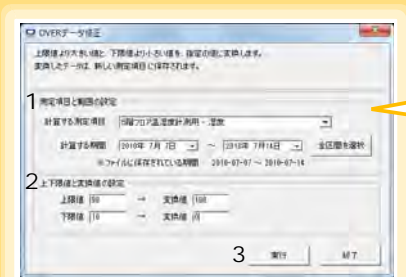

測定項目と範囲の設定  
変換したい項目と期間を設定します。


1. 項目と範囲を設定する。
2. 上限値、下限値、およびそれぞれの変換値を設定する。
3. **[実行]** ボタンをクリックする。  
(変換結果が保存されます)

※ **[終了]** ボタンをクリックすると、**[OVER データ修正]** ダイアログを閉じます。

# データを整理する

# 第6章


コンピュータに取り込んだデータを整理（コピー、削除、移動、合成、切り出し）ができます。PC アプリを使用します。




メイン画面を表示する  
クリック  
終了...

クリック

- 1 PC アプリが起動していない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、**[メイン画面を表示する]**をクリックする。  
メイン画面が表示されます。
- 2 **[データを整理]** ボタンをクリックする。  
データを整理画面が表示されます。
- 3 **[作業の種類]** を選択する。  
参照: 「6.1 データをコピーする、移動する」(⇒ p.74)  
「6.2 データを削除する」(⇒ p.75)  
「6.3 データを合成する」(⇒ p.76)  
「6.4 データを切り出す」(⇒ p.77)
- 4 作業するフォルダや記録ファイルを選択し、**[実行]** ボタンをクリックする。

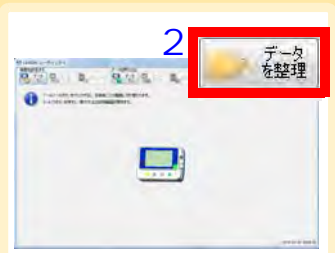

2 データを整理

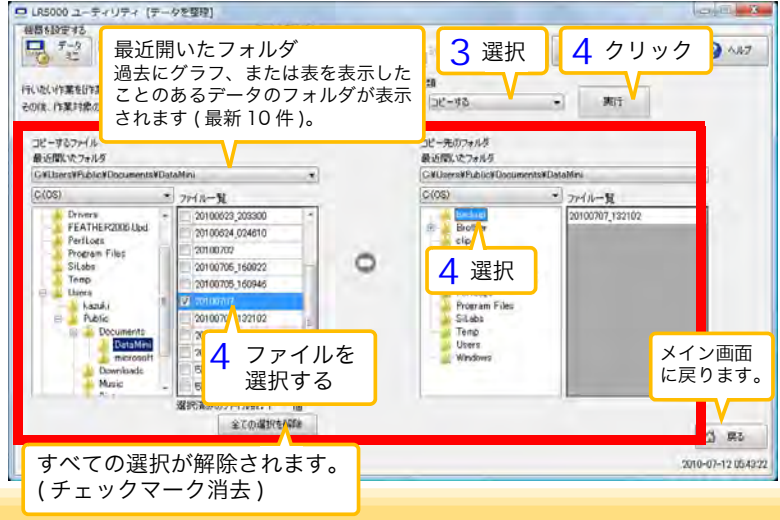

3 選択

4 クリック

4 選択

4 ファイルを選択する

最近開いたフォルダ  
過去にグラフ、または表を表示した  
ことのあるデータのフォルダが表示  
されます (最新 10 件)。


すべての選択が解除されます。  
(チェックマーク消去)

メイン画面  
に戻ります。

## 6.1 データをコピーする、移動する

データミニの記録ファイルを選択し、任意のフォルダにコピー、または移動します。

例：C:\¥Users¥Public¥Documents¥DataMini フォルダ内のファイルを  
C:\¥backup フォルダ内にコピーする

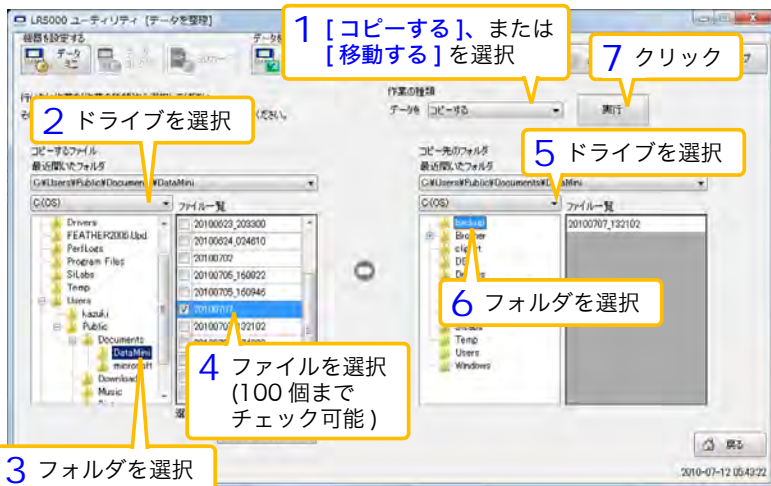




## 6.2 データを削除する

データミニの記録ファイルを選択し、削除します。

例：C:\¥Users¥Public¥Documents¥DataMini フォルダ内のファイルを削除する

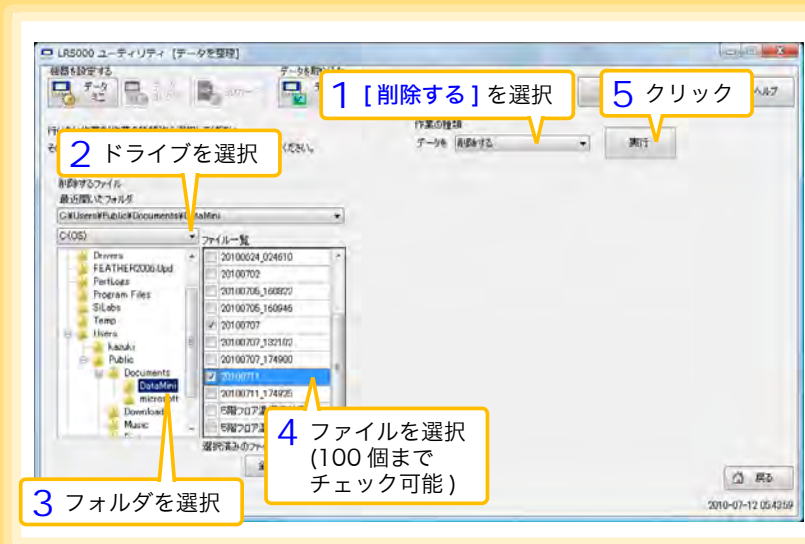


本器メモリのデータを削除したいときは？

参照：「データを削除」(⇒ p.40)

## 6.3 データを合成する

複数に分かれているデータミニの記録ファイルを選択し、一つの記録データに合成します。

例：C:\Users\Public\Documents\DataMini フォルダ内のファイル  
2010702などを合成して、C:\backup フォルダ内の合成データへ保存する。

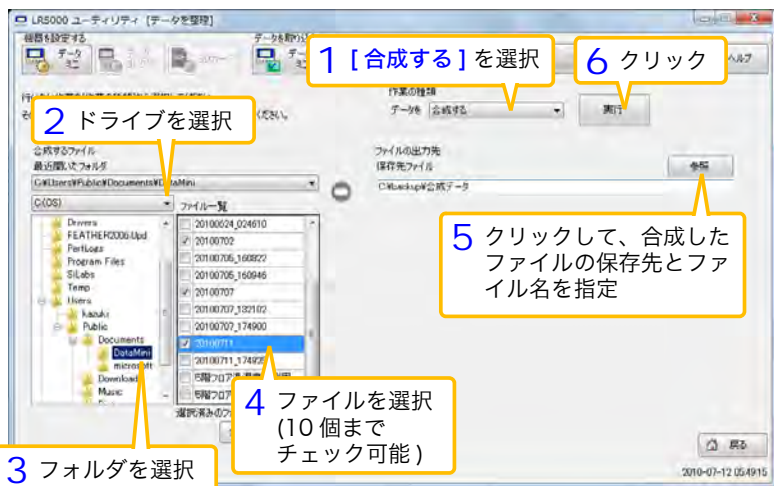

## 6.4 データを切り出す

データミニの記録ファイルから、特定の期間のデータを切り出して別のファイル名で保存します。

例：ファイル 20100707 の中の、7月13日のデータを切り出して、他のファイルに保存する。

1 [切り出す] を選択

2 ドライブを選択

3 フォルダを選択

4 ファイルを選択 (1 個)

5 切り出す期間と切り出すデータ (機種) を指定

6 クリックして、切り出したファイルの保存先とファイル名を指定


7 クリック

種別	機種コメント	製造番号	CH1コメント
1	LR5001	空調フロア温度検計...	summs002
2	LR5001	空調フロア湿度検計...	100005002




# オプション設定 (PC アプリ) 第 7 章

データミニから取り込んだデータの保存方法、機器の接続監視、およびデータミニ設定画面の機能などについて設定を変更できます。

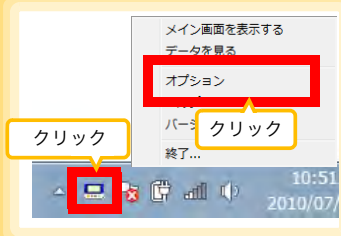

\* PC アプリが起動している場合は、メイン画面の【オプション】をクリックします。



- 1 PC アプリが起動していない場合は、タスクトレイのアイコンをクリックして、【設定】をクリックする。


オプション画面が表示されます。

- 2 設定内容を変更する。

参照：「7.1 取りこみデータの保存方法を変更する」(⇒ p.80)

「7.2 接続監視方法、データミニ設定画面の機能設定を変更する」(⇒ p.81)

- 3 【保存】ボタンをクリックする。

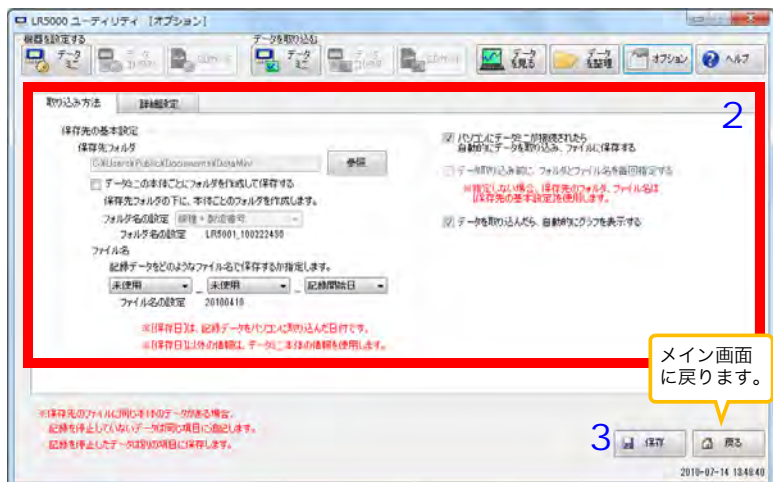


## 7.1 取りこみデータの保存方法を変更する


データミニから取り込んだデータの保存方法などの設定変更ができます。

### ① 保存先フォルダを変更したい

1 [取り込み方法] タブをクリック

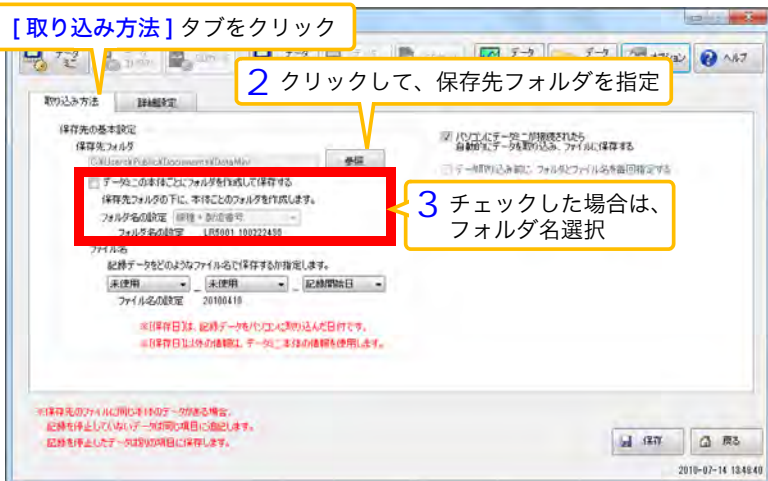


### ② ファイル名の付け方を変更したい

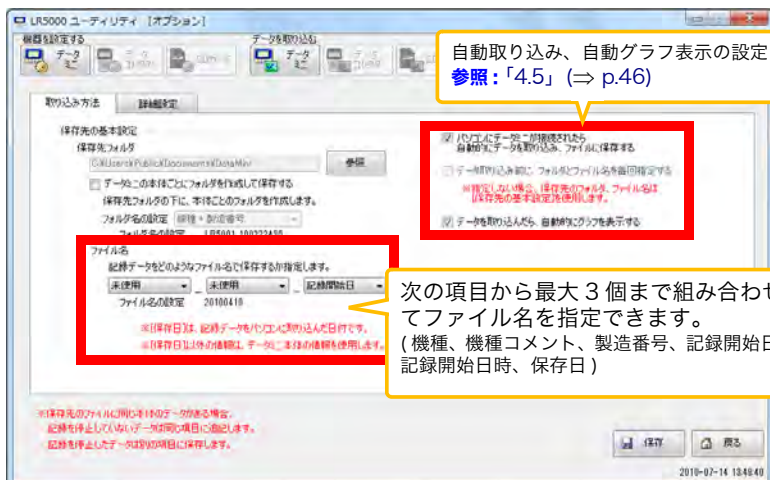


## 7.2 接続監視方法、データミニ設定画面の機能設定を変更する

機器の接続監視設定、およびデータミニ設定画面の機能設定を変更できます。

 機器の接続監視設定を変更したい

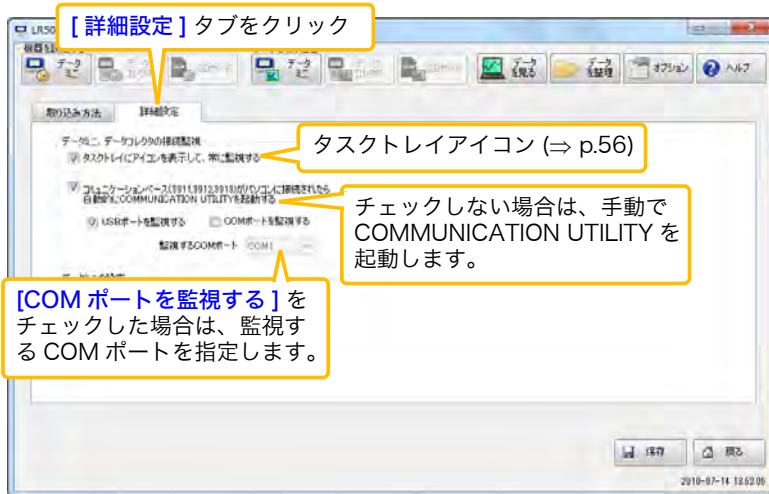

 データミニ設定画面の機能設定を変更したい

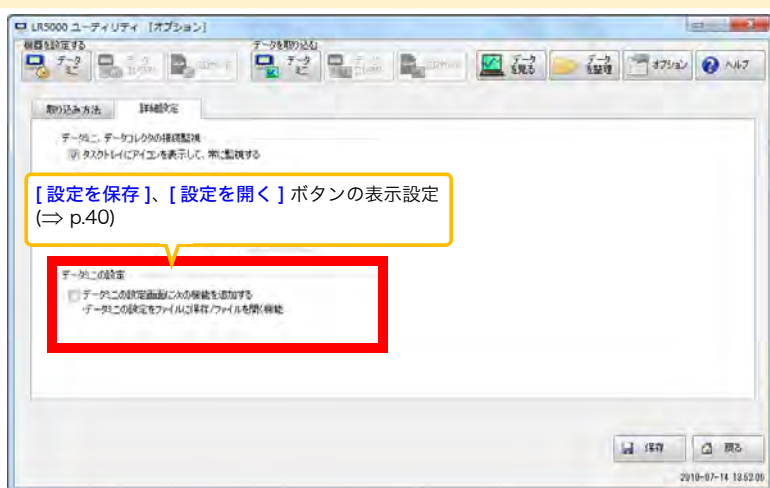





## 仕様

## 第 8 章

## 8.1 測定仕様

センサ	外付け温度センサ 2 チャンネル (K 熱電対) ミニチュアコネクタを使用
測定範囲	-40 ~ 800°C センサの種類によって制限されます
測定レンジ	-40.0 ~ 200.0°C (0.1°C 分解能) -40 ~ 800°C (1°C 分解能)
測定精度 (本体のみ)	±0.1%rdg.±0.5°C (-40.0 ~ 200.0°C 0.1°C 分解能) ±0.2%rdg.±1°C (-40 ~ 800°C 1°C 分解能) センサの測定精度は別途加算
精度保証温湿度範囲 (本体のみ)	温度: 23±5°C 湿度: 80%rh 以下 (結露なきこと)
温度係数	測定精度 × 0.05/°C ※ 23±5°C から外れる場合に測定精度に加算
精度保証期間	1 年間
製品保証期間	1 年間

## 8.2 機能仕様

表示部	LCD 表示
表示内容	測定値、測定チャンネル、単位 (°C)、記録中 (REC)、エンドレス記録 (ENDLESS)、統計値記録 (STAT)、記録間隔 (INTVL)、日付・時刻 (TIME)、アラーム (AL)、電池残量、記録データ数 (DATA)、最大値 (MAX)、最小値 (MIN)、省電力設定 (APS)
操作キー	4 個 (「設定」、「記録/停止」、「+」、「-」)
記録間隔	1/2/5/10/15/20/30 秒、1/2/5/10/15/20/30/60 分
記録モード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・瞬時値記録：記録間隔ごとの瞬時値を記録</li> <li>・統計値記録：1 秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、最小値、平均値を記録 (記録間隔が「1 秒」設定の場合は、選択不可)</li> </ul>
記録容量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・瞬時値記録 (60,000 データ /CH)</li> <li>・統計値記録 (15,000 データ /CH 瞬時値、最大値、最小値、平均値の 4 種類で 1 データ)</li> </ul>
記録開始方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体キー操作</li> <li>・即時 / 予約時刻 (コンピュータ / データコレクタから設定)</li> </ul>
記録停止方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体キー操作 (エンドレス記録)</li> <li>・本体キー操作 (ワнтаイム記録)</li> <li>・予約時刻 (エンドレス記録)</li> <li>・予約時刻 (ワнтаイム記録)</li> </ul> <p>予約時刻はコンピュータ / データコレクタから設定</p>
記録保持回数	開始操作 2 回分 (記録開始から停止までを 1 回分とする)
アラーム	コンピュータ / データコレクタから上下限値を設定し、設定範囲から外れた場合に表示部に表示
スケーリング	コンピュータ / データコレクタから条件を設定し、測定値をスケーリングして表示
省電力設定	任意キーの操作から約 30 秒経過で測定値表示を消灯 (省電力解除で常時表示)
時計機能	あり
断線検出機能	あり

## 8.3 その他

時計精度	±50ppm (温度 25°C 参考値)1 日あたり ±4.32 秒
バックアップ	記録データ、設定条件 (電池消耗による消失なし)
インタフェース	データミニ・通信アダプタ間、データミニ・データコレクタ間いずれも赤外線による調歩同期式シリアル通信 (半二重)
電源	<ul style="list-style-type: none"> <li>定格電源電圧 DC1.5 V× 2</li> <li>単 3 形アルカリ乾電池 (LR6)×2 電池交換時に記録動作、時計、最大値、最小値を約 30 秒間保持</li> </ul>
最大定格電力	0.1 VA
電池寿命	<ul style="list-style-type: none"> <li>約 1 年 (瞬時値記録、記録間隔 1 分、省電力、20°C の場合)</li> <li>約 1 か月 (記録間隔 1 秒、20°C の場合)</li> </ul>
外形寸法	約 79W × 60H × 37D mm
質量	約 160 g (電池含む)
防じん・防水性	なし
放射性無線周波数電磁界の影響	3V/m にて ±10°C
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) ..... 2 本 (本体に内蔵)</li> <li>取扱説明書 ..... 1 冊</li> <li>操作ガイド ..... 1 枚</li> </ul>
オプション	<ul style="list-style-type: none"> <li>LR5091 通信アダプタ</li> <li>LR5092 データコレクタ</li> <li>LR9691 K 熱電対コネクタ</li> <li>LR9692 K 熱電対</li> <li>9472-50 シース形温度プローブ</li> <li>9473-50 シース形温度プローブ</li> <li>9476-50 表面形温度プローブ</li> <li>Z5004 マグネット付きストラップ</li> </ul>
環境条件	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用場所: 屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで</li> <li>使用温湿度範囲: 0 ~ 50°C、80%rh 以下 (結露なきこと)</li> <li>保存温湿度範囲: -10 ~ 60°C、80%rh 以下 (結露なきこと)</li> </ul>
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全 : EN61010</li> <li>EMC : EN61326</li> </ul>

## 8.4 LR5091 通信アダプタ仕様

### 本体一般仕様

機能	データミニの赤外線信号をUSB信号に変換し、データミニとコンピュータ (USB) の通信を仲介する。
対応データミニ	LR5001 温湿度ロガー、LR5011 温度ロガー、LR5021 温度ロガー、LR5031 計装ロガー、LR5041 電圧ロガー (50 mV)、LR5042 電圧ロガー (5 V)、LR5043 電圧ロガー (50 V)、LR5051 クランプロガー、LR5061 パルスロガー ※ LR5051 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 1.01 以降で対応。 LR5031、LR5061 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 1.05 以降で対応。 LR5021 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応
使用温湿度範囲	温度 : 0 ~ 40°C、湿度 : 80%rh 以下 (結露なきこと)
保存温湿度範囲	温度 : -10 ~ 50°C、湿度 : 80%rh 以下 (結露なきこと)
製品保証期間	1 年間
使用場所	屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
電源	DC5 V (USB バスパワーにて動作)
最大定格電力	0.5 VA
外形寸法	約 83W×61H×19D mm (突起物含まず)
質量	約 43 g (USB ケーブル含まず)
適合規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 安全 : EN61010</li> <li>• EMC : EN61326</li> </ul>
USB 規格	USB2.0 準拠 Full Speed 対応
コネクタ	シリーズミニ B レセプタクル
接続機器	コンピュータ
通信速度	115,200bps
通信方法	赤外線による調歩同期式シリアル通信 (半二重)
通信速度	115,200bps

### 付属品

USB ケーブル (1 m) .....	1 本
LR5000 用 ユーティリティ (CD-R) .....	1 枚

## 付属 PC アプリ仕様

支給媒体	CD-R ..... 1 枚
動作環境	<p>以下の条件を満たすパーソナルコンピューター</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU: 動作クロック 1GHz 以上</li> <li>• メモリ: 512MB 以上</li> <li>• OS: Windows XP SP2 以上 / Vista SP1 以上 / 7</li> <li>• ライブラリ: .NET Framework 2.0/3.5</li> </ul> <p>インタフェース: USB (ただし、3910,3911 を使用する場合、または 9612 を使用する場合は COM ポートが必要)</p> <p>モニタ解像度: 1024x768 ドット以上</p> <p>ハードディスク: 空き容量 30MB 以上 (ただし、.NET Framework 2.0 または 3.5 がインストールされていない場合、別途約 500MB 必要。記録データの保存用に別途必要)</p>
通信対応機種	<p>LR5000 「データミニ」シリーズ全機種</p> <p>※ LR5051 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 1.01 以降で対応。 LR5031、LR5061 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 1.05 以降で対応。 LR5021 との通信は、付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応</p> <p>※ 以下の機種の設定、データ取り込みは COMMUNICATION UTILIY で対応、3910、3911 コミュニケーションベース、9612 RS-232C ケーブルを使用する場合は、コンピュータに COM ポートが必要</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 「データミニ」シリーズ全機種 (363x ~ 364x)</li> <li>• コミュニケーションベース 3910、3911、3912、3913</li> <li>• ワイヤレスロガー全機種</li> </ul>
通信時の接続形態	<p>LR5000 「データミニ」シリーズとの通信:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピュータ-USBケーブル-LR5091 通信アダプタ-LR5000「データミニ」シリーズ</li> <li>• コンピュータ -USB ケーブル -LR5092 データコレクタ -LR5000 「データミニ」シリーズ</li> </ul> <p>LR5092 データコレクタとの通信: コンピュータ-USB ケーブル-LR5092 データコレクタ</p>
設定機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LR5000 「データミニ」シリーズと通信し、設定の送信 / 取得</li> <li>• 個々の LR5000 「データミニ」シリーズに送信した設定をコンピュータ上に記憶</li> </ul> <p>(以下の機能は、付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR5092 データコレクタと通信し、設定の送信 / 取得</li> <li>• LR5092 データコレクタで使用するデータミニの設定を、通信または SD メモリカード経由で取得 / 保存</li> <li>• 個々の LR5092 データコレクタに送信した設定をコンピュータ上に記憶</li> </ul>
自動起動機能	タスクトレイに常駐し、コンピュータにデータミニ / データコレクタが接続された事を検出し、PC アプリを自動起動する事が可能

データ収集機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LR5000「データミニ」シリーズと通信し、記録データを収集</li> <li>• 記録データの合成が可能</li> <li>• LR5000「データミニ」シリーズに、コンピュータへ未収集の前回記録データがあった場合、収集可能</li> </ul> <p>(以下の機能は、付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR5092 データコレクタと通信し、データコレクタに保存されている記録データを収集</li> <li>• LR5092 データコレクタが SD メモリカードに保存したデータを収集</li> </ul>
グラフ表示機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大 16 チャンネルまでのグラフ表示</li> <li>• Y 軸の多軸表示 (最大 16 軸)</li> <li>• 時間軸は 1 軸</li> <li>• チャンネルごとに線の色、棒グラフ表示の ON/OFF、表示の ON/OFF が設定可能</li> <li>• 時間軸、縦軸の自動設定機能</li> <li>• Y 軸グリッド線の表示 ON/OFF、表示密度の設定が可能</li> <li>• 背景色を指定可能</li> <li>• グラフイメージをクリップボードにコピー</li> <li>• A/B カーソル機能</li> <li>• 統計データ (最大, 最小, 平均) 表示</li> </ul>
データ一覧表示機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 表形式で記録データの閲覧</li> <li>• 最大 600 チャンネルの表示</li> <li>• 統計データ (最大, 最小, 平均) 表示</li> </ul>
エクスポート機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• データ表に表示している全記録データの CSV 形式出力</li> <li>• データ表に表示している全記録データの EXCEL 貼り付け</li> <li>• A/B カーソル間の記録データを CSV 出力</li> <li>• A/B カーソル間の記録データを EXCEL 貼り付け</li> </ul>
インポート機能	<p>(付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応)</p> <p>3169 クランプオンパワーハイテストのテキストファイルを読み込み可能</p> <p>※読み込み可能なデータは記録間隔 1 秒以上のデマンドパラメータデータのみ (電力量、デマンド)</p>
印刷機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• グラフと統計データの印刷</li> <li>• 対応用紙サイズは A3、A4、B4</li> </ul>
データ加工機能	<p>スケールリング (<math>y=axx+b</math>)、電力演算、電力料金計算、稼働率計算、積算、露点温度計算、項目間演算、OVER データ修正</p>
ファイル管理機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• コンピュータに保存したデータのコピー / 削除</li> </ul> <p>(以下の機能は、付属 PC アプリ バージョン 2.00 以降で対応)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR5092 データコレクタが SD メモリカードに保存したデータの削除</li> </ul>
ヘルプ機能	ヘルプで操作説明を表示する

## 8.5 温度センサ仕様

### LR9692 K 熱電対



センサ種類	K 熱電対
許容差	クラス 1
測温接点形状	露出形（溶接）
センサ被覆	PFA（フッ素樹脂）
コネクタ部	ミニチュアプラグ、緑色
外形寸法	<ul style="list-style-type: none"> <li>素線径：φ0.2 mm</li> <li>センサ長：約 2000 mm</li> <li>コネクタ部：約 16.6W×20.15H×8D mm コンタクト除く</li> </ul>
質量	約 7.5 g
使用温湿度範囲	-50 ~ 250°C, 80%rh 以下（結露なきこと） コネクタ部は -50 ~ 200°C
保存温湿度範囲	-50 ~ 250°C, 80%rh 以下（結露なきこと） コネクタ部は -50 ~ 200°C
使用場所	屋内使用、汚染度 2、高度 2000 m まで
適合規格	IEC60584（JIS C 1602-1995 相当）

### 9472-50 シース形温度プローブ、9473-50 シース形温度プローブ

素線の種類	K
接点の種類	非接地形
許容差	JIS C 1602 クラス 1（旧階級 0.4 級相当） ±1.5°C（-40°C ≤ t < 375°C） ±0.004t（375°C ≤ t < 1000°C） （t：測定温度）
金属シース寸法	（9472-50）約 φ2.3×150 mm （9473-50）約 φ4.8×300 mm
補償導線	一般用（-20 ~ 90°C）約 1 m
測定温度	（9472-50）-100 ~ 300°C （9473-50）0 ~ 800°C
握り部耐熱	80°C
金属シース材質	SUS 316
耐電圧	AC500 V 1 分間
絶縁抵抗	100 MΩ 以上（DC500 V）

**9476-50 表面形温度プローブ**

素線の種類	K
接点の種類	接地形
測定確度	$\pm 2.5^{\circ}\text{C}$ [(t-ts) $\leq$ 100 $^{\circ}\text{C}$ ] $-0.03 \times t^{\circ}\text{C} \sim +2.5^{\circ}\text{C}$ [100 $^{\circ}\text{C}$ < (t-ts)] t: 測定温度 (-40 ~ 500 $^{\circ}\text{C}$ ) ts: 周囲温度 ( 0 ~ 40 $^{\circ}\text{C}$ )
測温部寸法	約 $\phi$ 20 mm
補償導線	一般用 (-20 ~ 90 $^{\circ}\text{C}$ ) 約 1 m
測定温度	-40 ~ 500 $^{\circ}\text{C}$
握り部耐熱	80 $^{\circ}\text{C}$

**外観図****9472-50、9473-50 シース形温度プローブ****9476-50 表面形温度プローブ**



# 保守・サービス

# 第9章

## 定期校正

本器の確度維持あるいは確認には、定期的な校正が必要です。

## 修理に出すときは

- ・ 本器を輸送する場合は、お届けしたときの梱包材料をご使用ください。
- ・ 輸送中に破損しないように梱包し、故障内容も書き添えてください。輸送中の破損については保証しかねます。
- ・ 修理品の送付先についてのお問合せは、お買い上げ店（代理店）が最寄りの営業所にご連絡ください。

## 本器を長期間使用しないときは

**注記** 電池の液漏れによる腐食と本器の損傷を防ぐため、長い間（1週間）使用しないときは、電池を抜いて保管してください。

## 9.1 クリーニング

本器の汚れをとるときは、柔らかい布に水か中性洗剤を少量含ませて、軽くふいてください。ベンジン、アルコール、アセトン、エーテル、ケトン、シンナー、ガソリン系を含む洗剤は絶対に使用しないでください。変形、変色することがあります。

**注記** 表示部は乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。


## 9.2 本器を廃棄するときは

地域で定められた規則に従って処分してください。

## 9.3 困ったときは

故障と思われるときは、「修理に出される前に」を確認してから、お買上店（代理店）が最寄りの営業所にご連絡ください。

### 修理に出される前に

困っていること	考えられる原因	対処方法・参照先
PC アプリをインストールできない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>インストールしようとしているコンピュータが PC アプリの動作環境に適していない。</li> <li>インストール方法が間違っている。</li> </ul>	<p>PC アプリの動作環境を確認して、動作環境に適したコンピュータでインストールを行ってください。</p> <p><b>参照:</b>「LR5000 用 ユーティリティの動作環境」(⇒ p.22)</p> <p>インストール手順を参照して、再度インストールしてください。特に次の点にご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「administrator」などの管理者権限でログインする。</li> <li>インストールを開始する前に、コンピュータで起動している全てのアプリケーションを終了させる。</li> <li>インストール画面が表示されないときは、X¥Japanese¥Setup.exe を実行する。</li> </ul> <p><b>参照:</b>「インストール手順」(⇒ p.22)</p>
測定値が表示されない。 	<p>センサを十分に奥まで差し込んでいない。</p> <p><b>注記</b> 記録データ数が 0 の場合、最大値および最小値は表示されません。</p>	<p>センサの向きを確認して、十分に奥まで差し込んでください。</p> <p>それでも表示されない場合は、センサ、および本体の修理・点検が必要です。お買上げ店（代理店）が最寄りの営業所にご連絡ください。</p> <p><b>参照:</b>「修理に出すときは」(⇒ p.91)</p> <p>PC アプリでこのデータを取り込むと、[ERROR] と表示されます。</p>
電池がすぐ終わる。	<ul style="list-style-type: none"> <li>購入時、本器に取り付けられていた電池をそのまま使用している。</li> <li>マンガン電池を使用している。</li> </ul>	<p>新品の単 3 形アルカリ乾電池 (LR6) をご使用ください。</p> <p><b>参照:</b>「2.1 電池を取り付ける (交換する)」(⇒ p.17)</p>
記録した値に調整をかけたが、どうしたらいいか？	-	<p>スケーリングを実行します。</p> <p><b>参照:</b>「5.1 スケーリングする」(⇒ p.65)</p> <p>あらかじめ、スケーリングの設定をしておくこともできます。</p> <p><b>参照:</b>「スケーリング (必要に応じて設定します)」(⇒ p.38)</p>


## 修理に出される前に

困っていること	考えられる原因	対処方法・参照先
記録を停止していないのに、[REC] マークが消えてしまっている。	停止方法がワンタイム記録に設定されている。	<p>ワンタイム記録の場合、メモリがいっぱいになると自動的に記録を停止します。停止方法をエンドレス記録に設定してください。</p> <p><b>参照:</b> 本器で設定する: 「停止方法 (メモリがいっぱいになったときの処理方法) を設定する」 (⇒ p.31)</p> <p><b>参照:</b> PC アプリで設定する: 「記録停止方法」 (⇒ p.37)</p> <p>(ただし、エンドレス記録に設定すると、メモリがいっぱいになったとき、古いデータから上書き保存していきますので、長期間データを記録する場合は、定期的にデータをコンピュータへ保存してください。記録を停止しなくてもデータをコンピュータへ保存できます)</p> <p><b>参照:</b> 「4.5 自動的に記録データをコンピュータへ取り込む (保存する)、グラフ表示する」 (⇒ p.46)</p>
本器のメモリを消したいが、どうしたらいいか?	-	<p>PC アプリを使用すると、消去できます。</p> <p><b>参照:</b> 「データミニ設定画面のその他の機能」 (⇒ p.40)</p> <p>また、本器の記録を開始すると自動的に前々回のデータが消去されます。(本体メモリには前回分と今回分のデータが保存されています)</p> <p><b>参照:</b> 「4.3 記録を開始・停止する」 (⇒ p.43)</p>
測定したはずのデータが消えてしまった。	記録停止後、再度記録を開始した。	記録を停止した後、誤って記録を開始してしまうと、前々回のデータは消えてしまうので、ご注意ください。(本体メモリには前回分と今回分のデータが保存されています)
画面に何も表示されない。	省電力設定が ON(有効) に設定されている。	<p>任意のキーを押すか、通信をすると表示されます。</p> <p><b>参照:</b> 「各部の名称と機能、表示部の説明」 (⇒ p.12)</p>
新しい LR5091(LR5092) を使うと、データミニと通信できない。	LR5091(LR5092) のデバイスドライバのインストールに失敗している。	<p>WindowsXP では、LR5091(LR5092) 1 台ごとに、ドライバのインストール作業が必要になる場合があります。</p> <p>LR5000 ユーティリティのヘルプの「困ったときには」に載っているドライバの再インストール手順を行ってください。</p>

## 9.4 エラー表示

本器がエラーの場合は、以下のように表示します。

### 本器のエラー表示

エラー表示	意味	対処方法・参照先
Err.1	調整データエラー： 内部調整データに異常が発生しました。	修理・点検が必要です。 お買い上げ店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。
Err.2	マイコン動作エラー： マイコンのROM/RAMに異常が発生しました。	参照：「修理に出すときは」（⇒ p.91）
Err.3	記録データエラー： 記録データあるいは設定データに異常が発生しました。	
o.F. または u.F.	測定値が測定範囲外です。	測定値が測定範囲外なので、表示できません。 PCアプリでこのデータを取り込むと、[OF] または [UF] と表示されません。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>センサを十分に奥まで差し込んでいない。</li> <li>センサが故障している。</li> <li>本器が故障している。</li> <li>LR9692 K 熱電対を使用している場合、途中で断線または、熱電対接点の溶接部が開放している。</li> </ul>	センサの向きを確認して、十分に奥まで差し込んでください。  それでも表示されない場合は、センサ、および本器の修理・点検が必要です。 お買い上げ店（代理店）か最寄りの営業所にご連絡ください。  参照：「修理に出すときは」（⇒ p.91）  PCアプリでこのデータを取り込むと、[ERROR] と表示されます。

### PC アプリのエラー表示

エラー表示	意味	対処方法・参照先
OF	測定値が測定範囲外です。	測定値が測定範囲外なので、表示できません。
UF		


# 付録

## 付録 1 記録モードについて

設定する記録モードによって、記録方法が異なります。以下を参考にしてください。

### 瞬時値記録


設定した記録間隔ごとに測定を行いメモリに記録します。

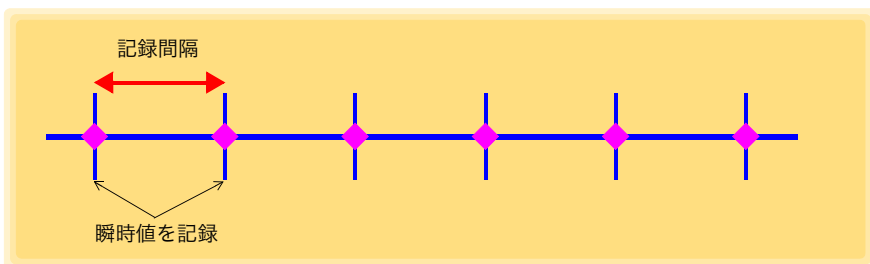

### 統計値記録

1秒ごとに測定を行い、記録間隔内の全データの最大値、最小値、平均値、および記録間隔ごとの瞬時値をメモリに記録します。

記録開始時のデータは、メモリに記録されません。(下記の場合だと、10:00:00のデータは記録されないことになります)

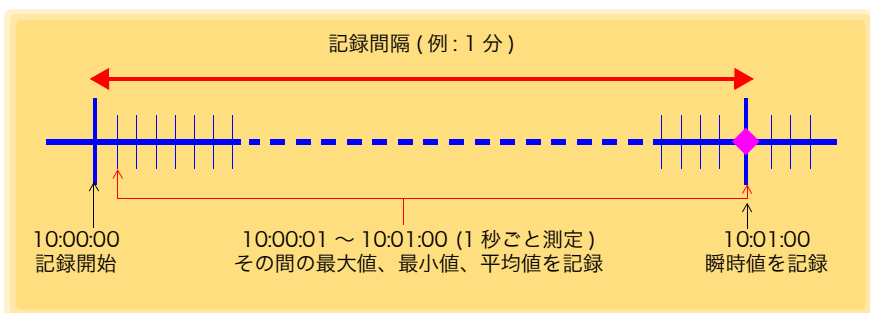

**注記** 記録間隔が「1秒」設定の時は、「統計値記録」は選択できません。

## 付 2

### 付録 2 記録間隔と最大記録時間

記録時間は、記録容量より算出したものです。

**注記** 最大記録時間は、電池の残量により制限されます。

#### 瞬時値記録の場合

記録可能なデータ数は、1チャンネルあたり 60,000 データです。

記録間隔	記録時間	記録間隔	記録時間
1 秒	16 時間 40 分	1 分	41 日 16 時間
2 秒	1 日 9 時間 20 分	2 分	83 日 8 時間
5 秒	3 日 11 時間 20 分	5 分	208 日 8 時間
10 秒	6 日 22 時間 40 分	10 分	416 日 16 時間
15 秒	10 日 10 時間	15 分	625 日
20 秒	13 日 21 時間 20 分	20 分	833 日 8 時間
30 秒	20 日 20 時間	30 分	1250 日
		60 分	2500 日

#### 統計値記録の場合

記録可能なデータ数は、1チャンネルあたり 15,000 データです。

記録間隔	記録時間	記録間隔	記録時間
1 秒 (設定不可)	-	1 分	10 日 10 時間
2 秒	8 時間 20 分	2 分	20 日 20 時間
5 秒	20 時間 50 分	5 分	52 日 2 時間
10 秒	1 日 17 時間 40 分	10 分	104 日 4 時間
15 秒	2 日 14 時間 30 分	15 分	156 日 6 時間
20 秒	3 日 11 時間 20 分	20 分	208 日 8 時間
30 秒	5 日 5 時間	30 分	312 日 12 時間
		60 分	625 日

## 付録 3 電池寿命の目安

記録間隔により電池寿命が異なります。

下表は、省電力設定 (⇒ p.32) を ON (有効) に設定した場合の値です。省電力設定を OFF (無効)、または記録モードを統計値記録に設定すると、電池寿命は約 1 か月になります。

記録間隔	電池寿命
1 秒	約 30 日
10 秒	約 6 か月
1 分以上	約 1 年

## 索引

## 配号

(-) キー .....	12
(+) キー .....	12

## A

AL マーク .....	13, 39
APS .....	32

## C

CD-R の取り扱いについて .....	6
----------------------	---

## D

DATA マーク .....	13
----------------	----

## E

ENDLESS マーク .....	13, 31
-------------------	--------

## I

INTVL マーク .....	13, 30
-----------------	--------

## L

LR5091 通信アダプタ .....	12
仕様 .....	86

## M

MAX マーク .....	13
MIN マーク .....	13

## P

PC アプリ	
アンインストール .....	24
インストール .....	22
画面構成 .....	25
起動 .....	23
動作環境 .....	22
バージョンアップ .....	24

## R

REC マーク .....	13, 43
REC マークが消える .....	93

## S

STAT マーク .....	13, 32
----------------	--------

## T

TIME マーク .....	13, 30
----------------	--------

## あ

アラーム判定 .....	13, 39
アンインストール .....	24
安全について .....	4

## い

移動する .....	74
印刷する .....	61
インストール .....	22
インストール画面が表示されない .....	23

## え

エラー表示 .....	94
エンドレス記録 .....	31, 37

## お

オプション .....	3, 42, 85
オプション設定 (PC アプリ) .....	79
温湿度センサ	
接続する .....	20
仕様 .....	89

## か

概要 .....	11
各部の名称と機能 .....	12
下限値 .....	39
過去のデータが見たい .....	60
稼働率計算 .....	68

## き

機器の接続監視設定 .....	81
機器を設定する (PC アプリ) .....	35
機種コメント .....	36
切り出す .....	77
記録 / 停止キー .....	12
記録開始方法 .....	37

## 2

### 索引

---

記録間隔	15, 30, 37, 44
記録時間	付 2
記録停止方法	15, 31, 37
記録データ数	14
記録データをコンピュータへ取り込む	46
記録モード	15, 32, 37, 付 1
記録を開始・停止する	43

### く

---

グラフの設定	51
グラフ表示する	46, 58, 59, 63
グラフを拡大したいときは	50
クリーニング	91

### こ

---

合成する	76
故障	92
コピーする	74
困ったときは	92
コンピュータに接続	34
コンピュータへ取り込み (保存)	46
梱包内容	2

### さ

---

サービス	91
最小値	14
最新データを見る	59, 63
最大記録時間	付 2
最大値	14
削除する	40, 75

### し

---

時刻の設定	15, 30, 40
磁石	42
自動グラフ表示	47, 58
自動取り込み	47, 80
修理	91, 92
瞬時値記録	32, 37, 付 1
仕様	83
上限値	39
省電力設定	12, 15, 32, 36, 45
電池寿命	付 2
使用前の確認	6

### す

---

スケールング	38, 40, 65
--------	------------

### せ

---

製品概要	11
積算	53, 54, 69

設置時の注意	5
設置する	42
設定画面 (本体)	15
設定画面から測定画面に切り替えたい	45
設定キー	12
設定項目一覧	29
センサ	20
センサ仕様	89

### そ

---

操作キー	12
操作フロー	7
測定	41
測定画面 (本体)	14
測定値	14
測定チャンネル	13
測定前の準備	17
測定前の点検	41

### ち

---

長期間使用しないときは	91
-------------	----

### て

---

定期校正	91
データ	
切り出す	77
合成する	76
コピーする	74
削除	40, 75
移動する	74
データ取り込み画面 (PC アプリ)	56
データミニ設定画面 (PC アプリ)	35
機能設定を変更したい	81
データミニ内の全データを取り込みなおす	58
データを整理する	73
データを見る	59, 63
データを見る画面 (PC アプリ)	59, 63
電気料金計算	67
電池がすぐ終わる	92
電池残量表示	13, 18
電池寿命の目安	付 2
電池を取り付ける	17
電力演算	66

### と

---

統計値記録	32, 37, 付 1
特長	11
時計の設定	15, 30, 40

### ね

---

年月日時分設定	30, 15, 37
---------	------------



**は**

バージョンアップ .....	24
廃棄する .....	91

**ひ**

ビューワ .....	47, 48, 59, 60, 63
表示更新時間 .....	12
表示されない .....	92
表示部の説明 .....	13

**ふ**

ファイル名の付け方を変更したい .....	80
-----------------------	----

**へ**

別のデータミニの設定を反映したい .....	36
------------------------	----

**ほ**

保守 .....	91
保存先フォルダを変更したい .....	80
保存済みの記録データをグラフ表示する .....	59
保存方法選択画面 (PC アプリ) .....	57, 58
保存方法を変更する .....	80
本体に記されているマーク .....	4

**め**

メイン画面 .....	25
メイン画面を表示する .....	56, 73
メモリがいっぱいになったときの処理方法設定 .....	31
メモリを消したい .....	93

**ゆ**

輸送上の注意 .....	3
--------------	---

**よ**

予約時刻 .....	37
------------	----

**れ**

レンジ .....	15
-----------	----

**ろ**

露点温度計算 .....	70
--------------	----

**わ**

ワンタイム記録 .....	31, 37, 43
---------------	------------



# 保証書

# HIOKI

形名 <b>LR5021</b>	製造番号	保証期間 購入日 年 月より1年間
---------------------	------	----------------------

本製品は、弊社の厳密な検査を経て合格した製品をお届けした物です。  
万一ご使用中に故障が発生した場合は、お買い求め先にご連絡ください。本書の記載内容で無償修理をさせていただきます。また、保証期間は購入日より1年間です。購入日が不明の場合は、製品の製造月から1年を目安とします。ご連絡の際は、本書を提示してください。また、確度については、明示された確度保証期間によります。

お客様 住所： 〒 \_\_\_\_\_  
ご芳名： \_\_\_\_\_

\*お客様へのお願い

- 保証書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。
- 「製造番号、購入日」およびお客様「住所、ご芳名」は恐れ入りますが、お客様にて記入していただきますようお願いいたします。

- 取扱説明書・本体注意ラベル（刻印を含む）等の注意事項にしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理いたします。また、製品のご使用による損失の補償請求に対しては、弊社審議の上購入金額までの補償とさせていただきます。なお、製造後一定期間を経過したものおよび部品の生産中止、不測の事態の発生等により修理不可能となった場合は、修理、校正等を辞退する場合がございます。
- 保証期間内でも、次の場合には保証の対象外とさせていただきます。
  - 製品を使用した結果生じる被測定物の、二次的、三次的な損傷、被害
  - 製品の測定結果がもたらす二次的、三次的な損傷、被害
  - 取扱説明書に基づかない不適当な取り扱い、または使用による故障
  - 弊社以外による修理や改造による故障および損傷
  - 取扱説明書に明示されたものを含む部品の消耗
  - お買い上げ後の輸送、落下等による故障および損傷
  - 外観上の変化（筐体のキズ等）
  - 火災、風水害、地震、落雷、電源異常（電圧、周波数等）、戦争・暴動行為、放射能汚染およびその他天災地変等の不可抗力による故障および損傷
  - 保証書の提出が無い場合
  - その他弊社の責任とみなされない故障
  - 特殊な用途（宇宙用機器、航空用機器、原子力用機器、生命に関わる医療用機器および車輛制御機器等）に組み込んで使用する場合で、前もってその旨を連絡いただかない場合
- 本保証書は日本国内のみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

サービス記録

年月日	サービス内容

## 日置電機株式会社

〒 386-1192 長野県上田市小泉 8-1

TEL 0268-28-0555

FAX 0268-28-0559







■ 外国代理店については弊社ホームページをご覧ください。

URL <http://www.hioki.com/>

- 本書の内容に関しては万全を期していますが、ご不明な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、本社コールセンターまたは最寄りの営業所までご連絡ください。
- 本書は改善のため予告なしに記載事項を変更することがあります。
- 本書には著作権によって保護される内容が含まれます。本書の内容を弊社に無断で転載、複製、改変することは禁止されています。

# HIOKI

日置電機株式会社

本社 TEL 0268-28-0555 FAX 0268-28-0559

〒386-1192 長野県上田市小泉 81

■ 製品の操作方法、技術的なお問い合わせはコールセンターまで

 **0120-72-0560**

(9:00～12:00, 13:00～17:00、土・日・祝日を除く)

TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail [info@hioki.co.jp](mailto:info@hioki.co.jp)

■ 修理・校正のご依頼はお買上店（代理店）または最寄りの営業所まで

また、ご不明な点がありましたらサービスお問合せ窓口まで

TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824 E-mail [cs-info@hioki.co.jp](mailto:cs-info@hioki.co.jp)

最寄りの営業所については弊社ホームページまたは  
QRコードからご覧いただけます。



URL <http://www.hioki.co.jp/>

1302