証明書番号	第****** - **号

見 本

5．偏置荷重　　＊試験荷重＝100 g

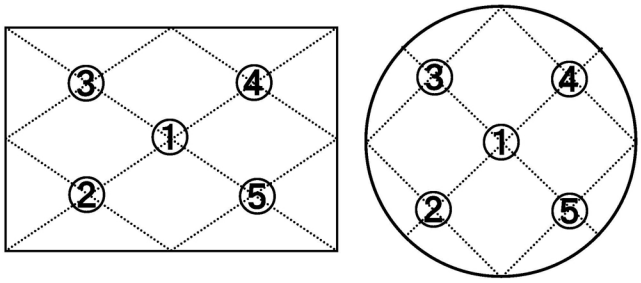

位置	指示値
①	100.0001 g
②	100.0000 g
③	100.0003 g
④	100.0002 g
⑤	99.9999 g
①との最大差	0.0002 g

6．正確さ

No.（I）	風袋荷重（Ti）	荷重（Wi）	指示値（Ii）
1	0 g	200 g	200.0001 g
2	0 g	50 g	50.0000 g
3	50 g	50 g	50.0000 g
4	100 g	50 g	50.0001 g
5	150 g	50 g	49.9999 g
6	50 g	50 g	50.0000 g

7．校正結果

風袋荷重	公称値	偏差	拡張不確かさ	包含係数 k
0 g	200 g	0.00011 g	0.00029 g	2
0 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2
50 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2
100 g	50 g	0.00010 g	0.00016 g	2
150 g	50 g	−0.00010 g	0.00016 g	2
50 g	50 g	0.00000 g	0.00016 g	2

備考

1）．　拡張不確かさは、信頼の水準約 95 %に相当し、包含係数 k は上記の通りである。

2）．　校正の条件

　　前負荷実施　　200 g

3）．　感度調整実施　　調整前　　：200.0008 g

　　使用分銅　：200 g（4_1）

以上