

メディカルモニター向けレクアガード オーダーシート



《お客様確認用》

①モニター確認

メーカー名	
モニター型番	

②ご使用になるモニターの形状をお選びください

- どちらかにチェックを入れてください


※縦横同サイズの場合は横型パネルをお選びください

※ベゼル部分のボタン類は、モニターの仕様によっては覆われる可能性があります

- 該当パネル図の□内に希望保護サイズをご入力ください

※サイズ指定が難しい場合は、弊社から提示させていただきます


※寸法公差は±1mmとなりますので、ご承知おきください

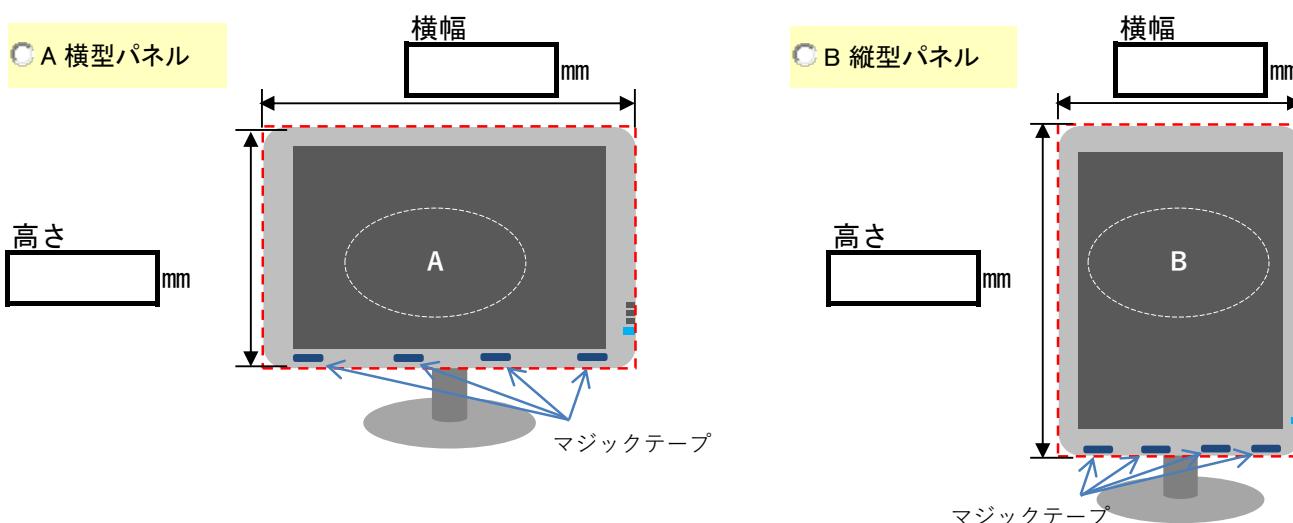

③モニタ下部の金具取付位置をお選びください

- どちらかにチェックを入れてください

※ベゼル部分のボタン位置をご考慮願います

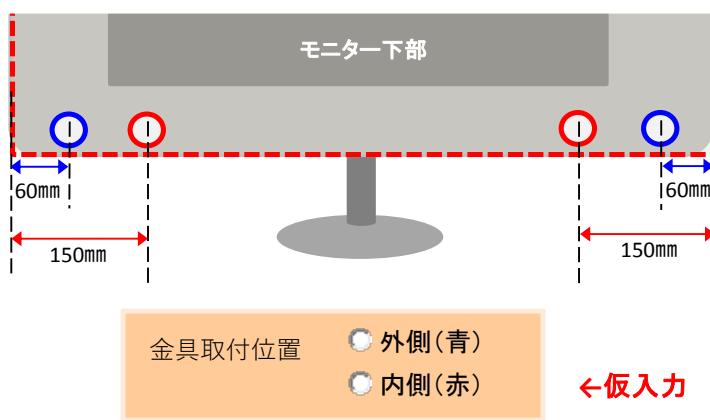

④取付に関する注意点

(設置先にご説明の上、ご承諾を得られましたら□にチェックを入れてください)

- 以下のご使用をする場合、使用前に設置不具合[※]がないか必ず確認を行ってください

・可動式モニター(アーム等)に本製品を設置した場合

・モニターを移動させた場合

・本製品の取り外し、再取付を行った場合

※不具合・・・落下防止ストラップの緩み、マジックテープ剥がれ等

ver. 220131

《ニデック使用欄》

パネル種類	横幅	高さ

品目番号	販売種類

※受注入力用(パネルサイズ)

横幅	高さ