Nakasu　製品の情報は弊社webまで　中洲電機　検索

PTP除包機


パラスター®



除包速度最大400%UP

パラスターシリーズは最高のスピード性能を実現しました。
手動タイプ（N-2C ver.2）は1分間に100～150錠※の除包が可能で、電動タイプ（N-2CME ver.1・N-2CSM ver.2 ）は1分間に300～400錠※の除包能力があります。操作は全てハンドルを回すかスイッチを回すだけ。指先の痛みや、手の疲れを感じずに除包作業が行えます。
調剤時の除包はもちろん、分包機のカセットへの薬剤充填など、一包化処方が多い調剤現場で行われる様々な業務に、飛躍的な効率アップをもたらします。

※同一薬剤を使用した場合（弊社調べ）

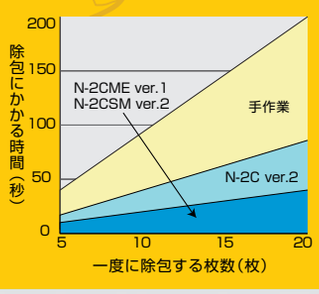




進化したゴミの出ない除包機構

パラスターシリーズは、自社開発の薬剤分離機構を採用し、従来にない確実性と簡単な操作性を実現しています。さらに各モデル共、業務に耐えられるシンプルで堅牢な構造で、実用性と耐久性を兼ね備えた安心してお使いいただける除包機です。除包の多寡によらず、どんな調剤業務にもぴったりフィットします。

専用トレーを標準装備

軽量で丸洗い可能なポリスチレントレー（N-2C・N-2CME）と、底面にふるいのような穴と、薬剤が転がるよう傾斜を持たせ、除包時に発生するゴミと薬剤との分離を手助けする専用メッシュトレー（N-2CSM）をそれぞれ標準装備。専用メッシュトレーは集塵装置との相乗効果で強力にゴミをを集め、排気をフィルタに通すことで、クリーンな作業環境を保てます。

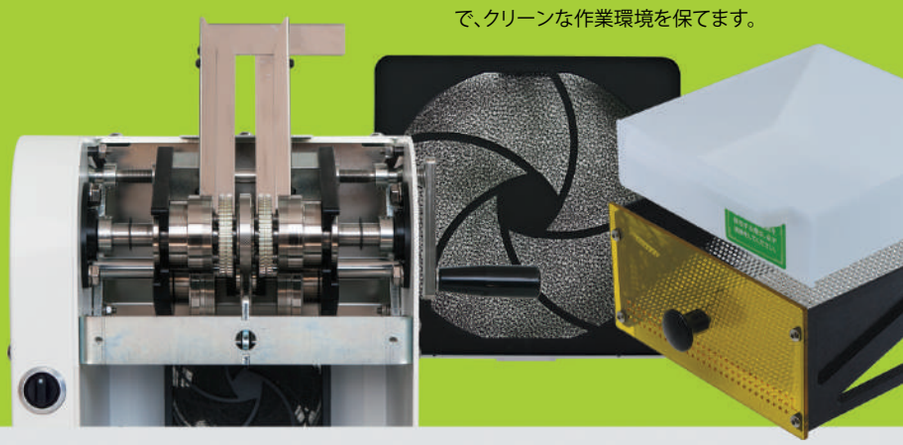




小さな薬剤から大きな薬剤まで

パラスターシリーズの大きな特徴として、従来の除包機では対応できなかった薬剤、特に指で押しても出しにくい小さな錠剤にも対応しています。※




カプセル錠・OD錠も抜ける

パラスターシリーズはカプセル錠やOD錠にも対応しています。従来除包機があまり得意ではなかったカプセル錠やOD錠も割れ・潰れなどを気にせず除包していただけます。※

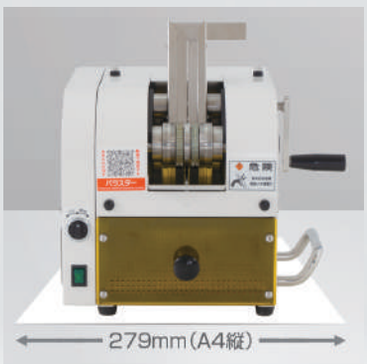

低重心・省スペース設計

調剤カウンターにフィットする省スペース設計。持ち運びも簡単。さらに重心を低く設計し、機器越しの棚へのアクセスも向上。A４用紙１枚がおけるスペースさえあればすぐにお使い頂けます。



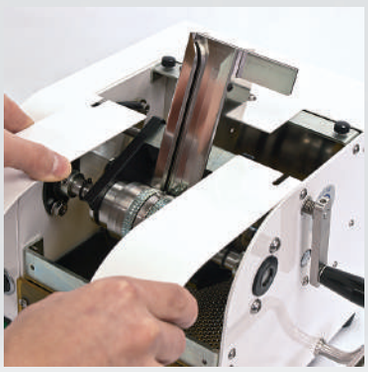


簡単メンテナンスで清潔仕様

口に入れる薬剤は衛生面も重要なポイント。パラスターシリーズはマニュアルに沿って簡単にメンテナンスができ、機器を常に清潔に保てます。また、オーバーホールサービスも提供しております。（写真：電動モデル）

※薬剤の大きさ・形状などにより一部除包できないものがあります。またソフトカプセル錠、一部OD錠は除包できません。お手持ちの薬剤でご確認の上ご使用下さい。

パラスター製品仕様

製品名称	パラスター Ⓡ		
型式	N-2C ver.2（コアモデル）	N-2CME ver.1（電動エコノミーモデル）	N-2CSM ver.2（電動モデル）
主な素材	鉄・ステンレス・POM・PP		
製品外観	 	 	 
外形寸法	幅315×奥行185×高さ245	幅275×奥行185×高さ310	幅275×奥行240×高さ280
重量	6kg	8.7kg	10kg
除包方式	手動	電動	電動
AC電源	なし	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
集塵機能	なし	なし	50Hzの時 0.95m³/min 60Hzの時 1.10m³/min
消費電力	なし	50Hzの時 15.3w 60Hzの時14w	50Hzの時 15.3w 60Hzの時14w
除包能力量※	100～150錠/min	300～400錠/min	300～400錠/min
対象薬剤	薬剤の高さ6mmまでの錠剤・OD錠・カプセル錠（一部OD錠・ソフトカプセル錠は除包できません）		
対象シート	薬剤間幅 最小21mm/最大55mmの2列シート（薬剤間幅は下図参照）		
付属品	専用トレー、出口ガイド、防塵シート	電源コード、専用トレー、出口ガイド、防塵シート	電源コード、専用メッシュトレー、出口ガイド、防塵シート

※同種の薬剤を使用時、弊社調べ


■ 適用外のシートは使用しないでください
対象外のシートを使用した場合、薬剤が欠けたりする場合がございます。製品パンフレットに記載の「対象シート」項目をよくお読みください。

■ 使用前に薬剤が対応できるか確認をお勧めします
当社は製品の品質、信頼性や除包精度の向上に努めておりますが、PTPシートや薬剤の材質・形状により、シート片が落下したり、欠けたりする場合がまれにございます。除包したことのない薬剤については、除包前にはシート1、2枚で試すなど確認してからご使用になられることをお勧めします。

■ 定期的に清掃をお願いします
定期的に清掃をおこなわれない場合、ローラー部の汚れやゴミの原因になりますので、メンテナンスマニュアルをご覧いただき、定期的に清掃をおこなって頂きますよう、お願い申し上げます。 1～2年ごとにオーバーホールをご依頼いただくと、より清潔に、長く機器をご利用いただけます。（オーバーホールの価格等はお気軽にお問い合わせください）

■ その他
各部部品には、部品加工時の痕が残る場合がございます（細い擦れ傷や、表面のくすみ）。品質に問題はございませんので、安心してお使いください。
本製品を使用して除包した薬剤について、その品質を保証するものではありません。薬剤の割れ・欠け、機械ゴミ・グリス等が付着が無いことを必ず確認していただきますようお願い致します。

対象シート参考図

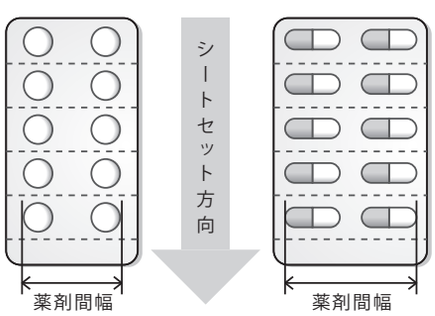

対象シートの条件に当てはまらない薬剤間幅のシートやソフトカプセル錠、
一部OD錠は除包できません。お手持ちの薬剤でご確認の上ご使用下さい。

こんなことでお困りの方にぜひ

- タイミングによっては患者様を待たせてしまう
- 誤投薬を防ぐために監査業務にもっと時間を割きたい
- 服薬指導など患者様とのやりとりの時間を増やしたい
- 薬剤の押し出し作業が続くと指先が痛くなる
- バラ錠では使い切れない薬剤をPTPシートに切り替えたい



⚠ 安全に関する注意	正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

※外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

中洲電機株式会社
〒501-3803 岐阜県関市西本郷通7丁目5番33号

製品に関するお問い合せは電話・FAXまたは弊社ホームページまで
電話：0575-22-5349 ／ FAX：0575-24-6160【受付時間／ 9:00～17:00 土・日・祝日は除く】
URL:www.nakasudenki.com