
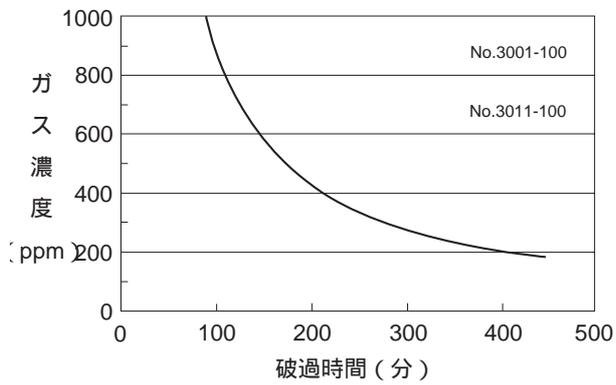
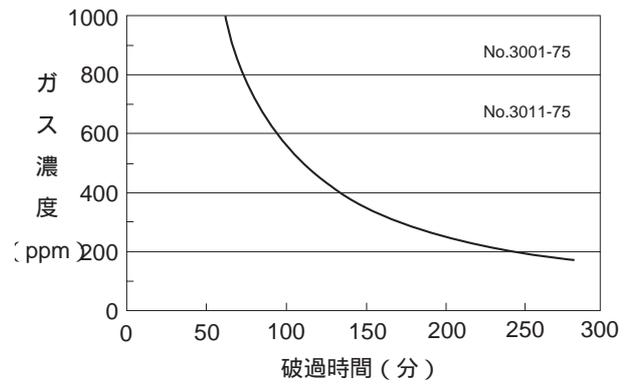


防毒マスク

8-5018-01.02.11 ~ 16

破過曲線図

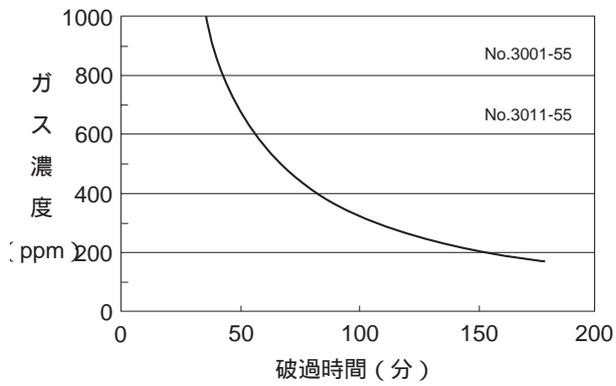

試験流量 30 ℓ/min
破過時間 5ppmの濃度を
検出するまでの時間
試験ガス 四塩化炭素
試験温度 20℃ ± 2℃
試験湿度 50% ± 5%